



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Aggiudicazione
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione generale centrale Organizzazione
Soggetto Emanante	Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento	Giorgio SACCO
Dirigente Responsabile	Giorgio SACCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "laddove ancora vigente ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 22 dicembre 2022 recante "Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e sue articolazioni funzionali per l'anno 2023";

PREMESSO CHE

- con decreto n. 3796/2023, successivamente rettificato con decreto n. 4496/2023, è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261, importo complessivo stimato 17.266.320,00 € IVA esclusa;
- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 28/07/2023 ore 14:00 del risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1689927510402	3D SYSTEM SRL 04289840268	Forma singola
1690372791997	ARTHREX ITALIA S.R.L 09301330966	Forma singola
1690384498564	BRM EXTREMITIES srl 08683610961	Forma singola
1690280596441	CORMED 01030110991	Forma singola
1690469053134	EPISCAN SRL 01546350669	Forma singola
1690370963042	EVOLUZIONI MEDICHE SRL UNIPERSONALE 03353370160	Forma singola
1690288813714	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	Forma singola
1690456539003	LIMACORPORATE 01427710304	Forma singola
1690384191805	LINK ITALIA 10517560156	Forma singola
1690269950707	MIKAI SPA 00972790109	Forma singola
1688720352223	PERMEDICA SPA 07747160153	Forma singola

1690299719761	STRYKER ITALIA srl S.U. 12572900152	Forma singola
1690365083578	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	Forma singola

- in data 01/08/2023 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale NP/2023/1112379 del 01/08/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- in data 31/08/2023, 04/09/2023 e 06/09/2023 si sono svolte le sedute riservate per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui ai verbali NP/2023/1220547 del 31/08/2023, NP/2023/1233005 del 04/09/2023 e NP/2023/ 1244301 del 06/09/2023, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- con decreto n. 5876/2023 si è proceduto all'ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente:

PARTECIPANTE	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
3D SYSTEM SRL 04289840268	6
ARTHREX ITALIA S.R.L 09301330966	6 – 7 – 8
BRM EXTREMITIES srl 08683610961	16
CORMED 01030110991	19
EPISCAN SRL 01546350669	14 – 15
EVOLUZIONI MEDICHE SRL UNIPERSONALE 03353370160	18 – 24
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	6 – 7 – 8 – 9
LIMACORPORATE 01427710304	5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12
LINK ITALIA 10517560156	6 – 7- 8 – 9

MIKAI SPA 00972790109	18 – 19
PERMEDICA SPA 07747160153	7 – 8 – 9
STRYKER ITALIA srl S.U. 12572900152	3 – 4 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14

- con decreto del Direttore Generale n. 6700/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 09/11/2023 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale NP/2023/1488562 del 09/11/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- NP/2023/1574279 del 23/11/2023;
- NP/2023/1785882 del 14/12/2023;
- NP/2023/1866707 del 21/12/2023;
- NP/2024/0034664 del 11/01/2024;
- NP/2024/0063007 del 18/01/2024;
- NP/2024/0090106 del 25/01/2024;

DATO ATTO che ad esito dell'esame in seduta riservata della documentazione tecnica sono state escluse le seguenti Ditte per le motivazioni precisate nelle relative comunicazioni di esclusione:

- LIMACORPORATE: lotti 8 – 9
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 7 - 14

DATO ALTRESI' ATTO che risultano deserti i seguenti lotti:

- LOTTO 1 - PROTESI TOTALI DI POLSO (CIG 983023133F)
- LOTTO 2 - PROTESI TOTALE DI SEMILUNARE (CIG 9830299B5A)
- LOTTO 11 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE IN PIROCARBONIO (CIG 98308409CD)
- LOTTO 17 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METATARSO FALANGEA
- IN LEGA METALLICA (CIG 98310062CC)
- LOTTO 21 - PROTESI ULNARE DISTALE (CIG 9831114BE9)
- LOTTO 22 - PROTESI RADIO-ULNARE DISTALE (CIG 9831140161)
- LOTTO 23 - PROTESI METACARPO FALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831162388)

PRESO ALTRESI' ATTO del verbale della seduta pubblica svoltasi in data 15/02/2024 (NP/2024/ 0179147), concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 15/02/2024 sopra richiamata, sono risultati i seguenti aggiudicatari per ciascun lotto di gara:

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	435.263,40 €	30,00	100,00

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	269.635,08 €	30,00	100,00

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE srl	70,00	198.000,00 €	30,00	100,00

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	67,61	237.300,00 €	28,49	96,10

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE	70,00	554.400,00 €	28,00	98,00

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	69,78	655.347,28 €	30,00	99,78

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	1.935.240,32 €	30,00	100,00

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 723.120,000	30,00	100,00

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 467.248,00	26,81	96,81

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	596.666,40 €	30,00	100,00

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	€ 346.231,800	30,00	100,00

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EPISCAN SRL	70,00	324.760,00 €	30,00	100,00

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	59,57	€ 63.376,560	30,00	89,57

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
---------------------	--	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------

MIKAI SPA	70,00	127.296,00 €	30,00	100,00
-----------	-------	--------------	-------	--------

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
CORMED SAS	70,00	653.200,00 €	29,44	99,44

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	595.650,00 €	30,00	100,00

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	70,00	866.278,40 €	30,00	100,00

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anomale, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

- 1) CORMED SAS.: lotto 19
- 2) LIMACORPORATE: lotti 5 - 7
- 3) MIKAI S.p.A.: lotto 18
- 4) STRYKER ITALIA SRL S.U.: 3 - 4 - 13 - 14 - 16 - 20
- 5) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 6 - 8 - 9 - 10 - 12

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici attesta la congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2024-0281409 del 12/03/2024, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui espressamente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2023/1112379 del 01/08/2023;
- NP/2023/1220547 del 31/08/2023;
- NP/2023/1233005 del 04/09/2023;
- NP/2023/ 1244301 del 06/09/2023;
- NP/2023/1488562 del 09/11/2023;
- NP/2023/1574279 del 23/11/2023;
- NP/2023/1785882 del 14/12/2023;
- NP/2023/1866707 del 21/12/2023;
- NP/2024/0034664 del 11/01/2024;
- NP/2024/0063007 del 18/01/2024;
- NP/2024/0090106 del 25/01/2024;
- NP/2024/ 0179147 del 15/02/2024;

2. DI CONFERMARE l'esclusione della LIMACORPORATE e della ZIMMER BIOMET ITALIA per le motivazioni indicate in premessa;

3. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	435.263,40 €	30,00	100,00

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
--------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------

STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	269.635,08 €	30,00	100,00
----------------------------	-------	--------------	-------	--------

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE srl	70,00	198.000,00 €	30,00	100,00

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	67,61	237.300,00 €	28,49	96,10

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE	70,00	554.400,00 €	28,00	98,00

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	69,78	655.347,28 €	30,00	99,78

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	1.935.240,32 €	30,00	100,00

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 723.120,000	30,00	100,00

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 467.248,000	26,81	96,81

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	596.666,40 €	30,00	100,00

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	€ 346.231,800	30,00	100,00

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EPISCAN SRL	70,00	324.760,00 €	30,00	100,00

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	59,57	€ 63.376,560	30,00	89,57

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
MIKAI SPA	70,00	127.296,00 €	30,00	100,00

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
CORMED SAS	70,00	653.200,00 €	29,44	99,44

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	595.650,00 €	30,00	100,00

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	70,00	866.278,40 €	30,00	100,00

3. DI DARE ATTO che risultano deserti i seguenti lotti:

- LOTTO 1 - PROTESI TOTALI DI POLSO (CIG 983023133F)
- LOTTO 2 - PROTESI TOTALE DI SEMILUNARE (CIG 9830299B5A)
- LOTTO 11 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE IN PIROCARBONIO (CIG 98308409CD)
- LOTTO 17 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METATARSO FALANGEA
IN LEGA METALLICA (CIG 98310062CC)
- LOTTO 21 - PROTESI ULNARE DISTALE (CIG 9831114BE9)
- LOTTO 22 - PROTESI RADIO-ULNARE DISTALE (CIG 9831140161)
- LOTTO 23 - PROTESI METACARPO FALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831162388)

4. DI DARE ALTRESI' ATTO che:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA srl S.U.	435.263,40 €	43.526,34 €

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
---------------------	---	--

STRYKER ITALIA srl S.U.	269.635,08 €	26.963,51 €
-------------------------	--------------	-------------

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
LIMACORPORATE srl	198.000,00 €	19.800,00 €

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	237.300,00 €	23.730,00 €

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
LIMACORPORATE	554.400,00 €	55.440,00 €

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	655.347,28 €	65.534,73 €

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	1.935.240,32	193.524,03 €

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
--------------	------------------------------	-----------------------------

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	€ 723.120,00	72.312,00 €
-----------------------------	--------------	-------------

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	€ 467.248,00	46.724,80 €

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA srl S.U.	596.666,40 €	59.666,64 €

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA srl S.U.	€ 346.231,800	34.623,18 €

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
EPISCAN SRL	324.760,00 €	32.476,00 €

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA srl S.U.	€ 63.376,560	6.337,66 €

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MIKAI SPA	127.296,00 €	12.729,60 €

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
CORMED SAS	653.200,00 €	65.320,00 €

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
STRYKER ITALIA srl S.U.	595.650,00 €	59.565,00 €

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	866.278,40 €	86.627,84 €

- la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatrici sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

5. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

6. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sul Tenders Electronic Daily (TED) secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 nonché sul Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel (www.ariaspa.it);

7. DI DARE ATTO CHE le spese di pubblicità legale sostenute per la procedura de qua saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1112379
del 01/08/2023

Genova, 01/08/2023

Prot. n. NP/2023/1112379

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 01/08/2023, alle ore 12,05 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D’Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l’apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente S.U.A.R., RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – con funzioni Segretario verbalizzante

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Simone Manenti della S.U.A.R.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Sara Bugatto, nominata con decreto del Direttore Generale n. 1939/2023.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-1049842 del 24/07/2023.

Il RUP dà preliminarmente atto che con decreto n. 3796/2023, successivamente rettificato con decreto n. 4496/2023, è stata indetta la procedura di cui in epigrafe e fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 28/07/2023, ore 14:00.

Il RUP rileva che entro il predetto termine delle ore 14:00 del 28/07/2023 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1689927510402	3D SYSTEM SRL 04289840268	Forma singola
1690372791997	ARTHREX ITALIA S.R.L 09301330966	Forma singola
1690384498564	BRM EXTREMITIES srl 08683610961	Forma singola
1690280596441	CORMED 01030110991	Forma singola
1690469053134	EPISCAN SRL 01546350669	Forma singola
1690370963042	EVOLUZIONI MEDICHE SRL UNIPERSONALE 03353370160	Forma singola
1690288813714	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 08082461008	Forma singola
1690456539003	LIMACORPORATE 01427710304	Forma singola
1690384191805	LINK ITALIA 10517560156	Forma singola
1690269950707	MIKAI SPA 00972790109	Forma singola
1688720352223	PERMEDICA SPA 07747160153	Forma singola
1690299719761	STRYKER ITALIA srl S.U. 12572900152	Forma singola
1690365083578	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. 09012850153	Forma singola

Il RUP dà quindi lettura delle ditte partecipanti per ciascuno dei lotti di gara:

LOTTO 1 - PROTESI TOTALI DI POLSO (CIG 983023133F)

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 2 - PROTESI TOTALE DI SEMILUNARE (CIG 9830299B5A)

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE
LIMACORPORATE srl

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE
3D SYSTEM SRL
ARTHREX ITALIA S.R.L
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
LIMACORPORATE
LINK ITALIA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE
ARTHREX ITALIA S.R.L
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
LIMACORPORATE
LINK ITALIA

PERMEDICA SPA
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE
ARTHREX ITALIA S.R.L
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
LIMACORPORATE
LINK ITALIA
PERMEDICA SPA
STRYKER ITALIA srl S.U.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
LIMACORPORATE
LINK ITALIA
PERMEDICA SPA
STRYKER ITALIA srl S.U.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA srl S.U.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 11 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE IN PIROCARBONIO (CIG 98308409CD)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE
LIMACORPORATE srl.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE
EPISCAN SRL
STRYKER ITALIA srl S.U.
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE
EPISCAN SRL

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE
BRM EXTREMITIES srl
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 17 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METATARSO FALANGEA IN LEGA METALLICA (CIG 98310062CC)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE



MIKAI SPA
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE
CORMED SAS
MIKAI SPA
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE
STRYKER ITALIA srl S.U.

LOTTO 21 - PROTESI ULNARE DISTALE (CIG 9831114BE9)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 22 - PROTESI RADIO-ULNARE DISTALE (CIG 9831140161)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 23 - PROTESI METACARPO FALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831162388)
NESSUNA OFFERTA

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE

Il RUP, operando attraverso il Sistema, procede quindi alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- 1) della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- 2) della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla *lex specialis* (art. 15.2.1 del Disciplinare) come di seguito elencati:
 - a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
 - b) DGUE (come da modello M-2)
 - c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
 - d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere

- corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 - f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
 - g) (eventuale) procura
 - h) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
 - i) (eventuale) referenze bancarie
 - j) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
 - k) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
 - l) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
 - m) Patto d'integrità

Successivamente, in seduta riservata, il RUP procederà alla verifica del contenuto e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Al termine delle operazioni il RUP dà atto che per tutte le Ditte offerenti risultano conformi la ricezione dell'offerta presentata, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti nei campi Sintel.

Alle ore 12,10 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 7 (sette) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 01/08/2023

RUP


Dott. Giorgio SACCO

Ufficiale Rogante


Dott.ssa Sara BUGATTO

Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

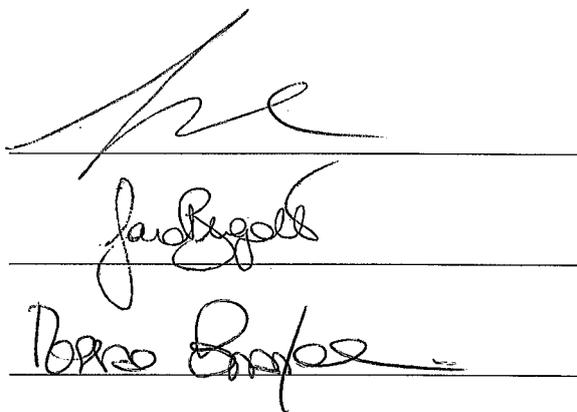

The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most stylized, the middle one is more legible, and the bottom one is also quite stylized.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1220547
del 31/08/2023

Genova, 31/08/2023

Prot. n. NP/2023/1220547

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

I ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 31/08/2023, alle ore 8,20 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott.ssa Rossana Brandolin, per procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2023/1112379 del 01/08/2023).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
- g) (eventuale) procura
- h) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- i) (eventuale) referenze bancarie
- j) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- k) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- l) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- m) Patto d'integrità firmato digitalmente

3D SYSTEM SRL		
Lotti di partecipazione:	6	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI CCIAA DI TREVISO E BELLUNO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 04289840268	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 3.507.954,33 fatturato specifico medio annuo: 1.689.851,33	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 01326/34/49413452 rilasciata da Helvetia S.A. importo Euro 2.311,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	4707-8065-5074-7517	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	

F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME
Patto d'Integrità	CONFORME
ESITO:	AMMESSO

ARTHREX ITALIA S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	6 - 7 - 8	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO MONZA BRIANZA LODI CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 0930133096	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 17.856.355,00 fatturato specifico medio annuo: € 10.883.974,95	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 113855321 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. importo Euro 19.059,20	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8686-0863-0379-5820 7136-1607-3691-6661 8326-2781-7817-7842	CONFORME
Procura (eventuale)	PRESENTE	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

103

BRM EXTREMITIES S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	16	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	ESENTE	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 2042387	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 595.066,00 fatturato specifico medio annuo: € 74.670,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2046.00.27.2799865642rilasciata da Sace BT S.p.A. importo Euro 585,00	CONFORME (50%, è una PMI)
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6526-2842-7546-3503	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

CORMED DI CORO' CLAUDIO E C. SAS	
Lotti di partecipazione:	19
Istanza di partecipazione	CONFORME

DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Genova CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 01030110991	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 850.322,00 fatturato specifico medio annuo: € 850.322,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 410069058 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. importo Euro 4.600,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2962-0105-8090-1619	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

EPISCAN S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	14 - 15	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 01546350669	CONFORME

Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 2.301.706,66 fatturato specifico medio annuo: € 2.301.706,66	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. B.2023.1247285 rilasciata da Accelerant Insurance Europe S.A. importo Euro 4.452,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5601-2272-1778-5738	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	


La seduta si chiude alle ore 10,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 31/08/2023


RUP

Dott. Giorgio SACCO

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

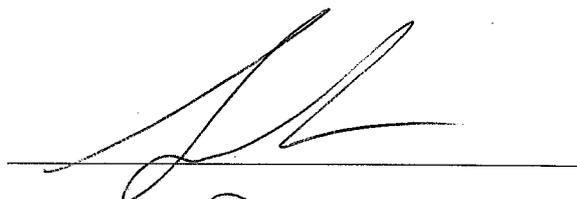

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1233005
del 04/09/2023

Genova, 04/09/2023

Prot. n. NP/2023/1233005

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

II^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 04/09/2023, alle ore 8,30 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott. Giorgio Sacco, per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP prosegue la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2023/1112379 del 01/08/2023).

EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	
Lotti di partecipazione:	18 – 24
Istanza di partecipazione	CONFORME
DGUE	CONFORME
Contributo ANAC	CONFORME

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI CCIAA DI BERGAMO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE : 03353370160	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 1.994.373,70 fatturato specifico medio annuo: € 379.714,85	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 6001410835 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. importo Euro 5.428,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8083-4318-5013-1512	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	PRESENTI	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		
Lotti di partecipazione:	6 - 7 - 8 - 9	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA n. Iscrizione 08082461008 - Data di iscrizione: 13/07/2004	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 473.442.980,00	CONFORME

	fatturato specifico medio annuo: € 40.322.768,94	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000087888 rilasciata da Banca nazionale del Lavoro Paribas S.p.A. importo Euro 19.112,80	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2306-7788-8207-0997	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	NO	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* In allegato all'Istanza di partecipazione e al DGUE la Ditta ha dichiarato che in data 2 marzo 2021, il Giudice dell'Udienza Preliminare, ha disposto rinvio a giudizio nei confronti di Johnson & Johnson Medical S.p.A. nel procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ipotizzato illecito amministrativo previsto dall'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli art. 319, 319 bis c.p., in ipotesi commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), d.D.lgs. n. 231/2001. In esito a tale giudizio, con sentenza non definitiva 6 marzo 2023, n. 3314, il Tribunale di Milano, X sezione penale, ha ritenuto Johnson & Johnson Medical S.p.A. responsabile dell'illecito amministrativo ascritto e ha condannato la Società al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200.000, riconoscendole l'attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 231 del 2001, per avere risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose dell'illecito. La Ditta precisa che non è stata applicata, con la predetta sentenza, alcuna sanzione interdittiva, sia in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 231 del 2001, la Società stessa ha provveduto all'integrale risarcimento del danno, sia in quanto, benché all'epoca dei fatti contestati avesse già adottato e attuato un modello organizzativo e gestionale ex d. lgs. n. 231 del 2001, ha provveduto all'aggiornamento dell'assetto organizzativo e procedurale delle aree interessate dal procedimento penale sopraccitato, così adottando misure idonee, ex art. 17, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231 del 2001, a prevenire la commissione di reati della specie di quello contestato, come anche previsto in tema di self cleaning dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC.

✓

DB

Alla luce di quanto rappresentato dalla Società ed alla luce delle misure di self cleaning adottate, nel caso di specie non si ritiene configurabile alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

LIMACORPORATE SPA		
Lotti di partecipazione:	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Registro delle Imprese di Pordenone-Udine numero REA: UD - 173824 (data iscrizione 18/03/1986)	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 155.549.056,77 fatturato specifico medio annuo: € 155.487.346,07	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 410056247 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. importo Euro 25.739,20	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2835-8791-0779-4525	CONFORME
Procura (eventuale)	PRESENTE	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

LINK ITALIA SPA		
Lotti di partecipazione:	6 - 7 - 8 - 9	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI MILANO	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 11.196.349,00 fatturato specifico medio annuo: € 11.196.349,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 2013174 rilasciata da B REVO INSURANCE S.p.A . importo Euro 27.304,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8027-6024-3637-6842	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

MIKAI SPA		
Lotti di partecipazione:	18 - 19	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI GENOVA CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 00972790109 dal 19/02/1996	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 9.554.473,67 fatturato specifico medio annuo: € 596.546,52	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. E1505873 rilasciata da B_ITAS MUTUA importo Euro 5.620,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	0119-5759-8057-5991	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorti (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo		CONFORME
Patto d'Integrità		CONFORME
ESITO:		AMMESSO

PERMEDICA SPA		
Lotti di partecipazione:		7 - 8 - 9
Istanza di partecipazione		CONFORME
DGUE		CONFORME
Contributo ANAC		CONFORME
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI LECCO CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 07747160153 dal 06/02/1992	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 23.307.713,33	CONFORME

	fatturato specifico medio annuo: € 704.646,66 (ALLEGA REFERENZE BANCARIE)	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 535191113 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. importo Euro 24.994,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5714-6206-2805-6698	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	PRESENTE	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

STRYKER ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Roma CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 12572900152 dal 12/04/2000	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 142.437.384,00 fatturato specifico medio annuo: € 29.951.549,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti*	CONFORME

Cauzione provvisoria	Polizza n. 2011127 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. importo Euro 43.679,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8978-2726-3362-3582	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

* Stryker Italia dichiara di aver subito, ad agosto 2022, il recesso contrattuale di una fornitura di lieve entità, per cause legate alla mancata disponibilità di materiale presso lo stabilimento di produzione. La Stazione appaltante, cui sono stati comunicati i tempi presunti di risoluzione della problematica, ha ritenuto di recedere dal contratto in considerazione dell'urgenza, senza ulteriore onere di spesa a carico di Stryker.

Considerate le ragioni alla base del recesso, nonché l'assenza di oneri a carico della Ditta, si ritiene che tali fattispecie non configurino "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili" e, dunque, non integrino un'ipotesi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ZIMMER BIOMET ITALIA SRL		
Lotti di partecipazione:	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI Milano CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE 09012850153 dal 19/02/1996	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 148.333.413,00	CONFORME

	fatturato specifico medio annuo: € 3.119.395,05	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	<i>manca elenco forniture nel settore di gara</i>	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 5490800577 rilasciata da rilasciato da Citibank N.A. . importo Euro 36.494,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente (certificazione ISO 13485 che, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria del 50%, si ritiene equivalente al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000)	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	0873-5311-2401-2434	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorti (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo		CONFORME
Patto d'Integrità		CONFORME
ESITO:	VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO	

Il RUP dà atto che, ad esito della verifica amministrativa, verrà attivato il soccorso istruttorio nei riguardi della Zimmer Biomet Italia per la carenza sopra indicata.

La seduta si chiude alle ore 12,00.


Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 04/09/2023

RUP
Dott. Giorgio SACCO

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN







REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1244301
del 06/09/2023

Genova, 06/09/2023

Prot. n. NP/2023/1244301

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

III^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 06/09/2023, alle ore 13,00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott. Giorgio Sacco, al fine di esaminare la documentazione trasmessa dalla Ditta nei riguardi della quale era stato attivato il soccorso istruttorio.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP ricorda anzitutto che al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla presente procedura si era disposto di attivare il soccorso istruttorio nei riguardi della Zimmer Biomet in quanto non aveva indicato nel DGUE l'elenco delle principali forniture di cui all'art. 8.3 del Disciplinare.

Con nota Prot-2023-1233598 del 04/09/2023 è stato conseguentemente attivato il soccorso istruttorio per le carenze sopra indicate.

In data 06/09/2023 tramite piattaforma Sintel (ID 173.808.038), la Zimmer Biomet ha trasmesso l'elenco delle principali forniture di cui all'art. 8.3 del Disciplinare.


La Zimmer Biomet Italia, avendo trasmesso quanto richiesto nel termine previsto, risulta ammessa al prosieguo della procedura.

La seduta si chiude alle ore 13,05.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 06/09/2023

RUP

Dott. Giorgio SACCO

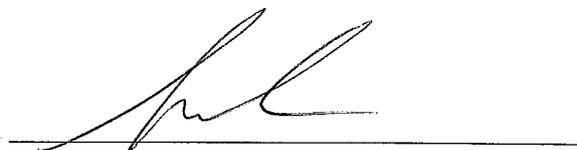A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sacco', written above a horizontal line.

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rossana Brandolin', written above a horizontal line.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

Genova, 09/11/2023

Prot. n. NP/2023/1488562

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 09/11/2023, alle ore 9,06 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D’Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per procedere all’apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente S.U.A.R., RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – con funzioni Segretario verbalizzante

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I P.O. Ponente

Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Sara Bugatto, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-1435142 del 30/10/2023.

Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito www.ariaspa.it.

Il RUP, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte partecipanti.

Il Disciplinare di Gara (art. 15.2.4.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

- 1) Offerta Tecnica
- 2) Questionario tecnico
- 3) Scheda tecnica
- 4) Confezionamento
- 5) Certificato CE
- 6) Eventuali dichiarazioni di equivalenza
- 7) Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici
- 8) Offerta Economica Silente

Il RUP e la Commissione Giudicatrice valutate rilevano quanto segue:
in tutti i lotti è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

Alle ore 9,27 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.


Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 09/11/2023


Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Marcello FEDERICI

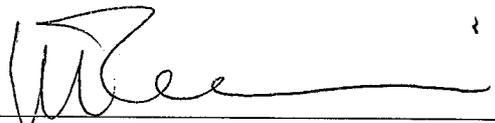


Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO

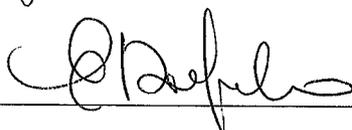



Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Francesco RATTO

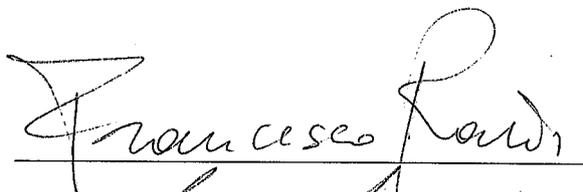


RUP

Dott. Giorgio SACCO

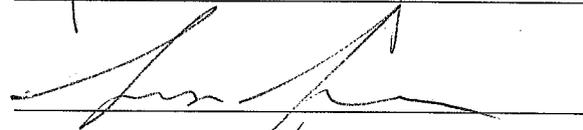


Ufficiale Rogante

Dott.ssa Sara BUGATTO

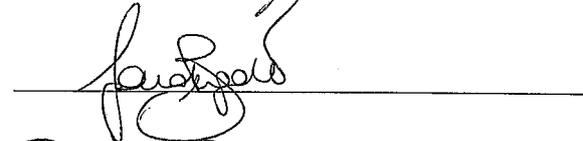


Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN







REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1574279
del 23/11/2023

Genova, 23/11/2023

Prot. n. NP/2023/1574279

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

1^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 1^ seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 23/11/2023, alle ore 10,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 "Savonese"	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA srl S.U.	APSI (Adaptative Proximal Scafoid Implant)	X

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA srl S.U.	RCPI Impianto in pirocarbonio di resurfacing del capitato	X

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
LIMACORPORATE srl	SMR RESURFACING	X

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
3D SYSTEM SRL	FX Solutions	X
ARTHREX ITALIA S.R.L	ECLIPSE	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Global Icon	X
LIMACORPORATE	SMR	X
LINK ITALIA	EMBRACE	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	COMPREHENSIVE	X



LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	Univers™ Apex Shoulder System	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	DELTA XTEND	X
LIMACORPORATE	SMR	X
LINK ITALIA	EMBRACE	X
PERMEDICA SPA	MIRAI	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	COMPREHENSIVE	X

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
ARTHREX ITALIA S.R.L	UNIVERS REVERS	X
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	DELTA XTEND	X
LIMACORPORATE	SMR	X
LINK ITALIA	EMBRACE	X
PERMEDICA SPA	MIRAI	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza di molteplici fori di sutura
STRYKER ITALIA srl S.U.	ASCEND FLEX	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza di molteplici fori di sutura
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	BIGLIANI-FLATOW	X

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	DELTA XTEND	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza del seguente requisito di minima: avere la parte prossimale riempitiva, un rivestimento adatto e relativi fori per suture al fine di garantire un ottimo riposizionamento e stabilità delle tuberosità
LIMACORPORATE	SMR	X
LINK ITALIA	EMBRACE	X
PERMEDICA SPA	MIRAI	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza di molteplici fori di sutura
STRYKER ITALIA srl S.U.	ASCEND FLEX	La Commissione ritiene necessario chiedere un chiarimento in merito alla presenza di molteplici fori di sutura
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	ANATOMICAL SHOULDER	X

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA srl S.U.	RHS	X

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	EXPLOR	X
-----------------------------	--------	---

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
LIMACORPORATE srl	DISCOVERY	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	NEXEL	X

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA srl S.U.	LATITUDE	X

La seduta si interrompe dalle 13,00 alle 13,45 per la pausa pranzo.

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
EPISCAN SRL	PROTESI TIBIOTARSICA ANALLERGICA AAA	X
STRYKER ITALIA srl S.U.	INFINITY	X
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	TM ANKLE	X

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
EPISCAN SRL	PROTESI TIBIOTARSICA ANALLERGICA AAA	X

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
BRM EXTREMITIES srl	SILKTOE	X
STRYKER ITALIA srl S.U.	SWANSON METATARSOFALANGEA	X

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	DIGITALIS	X
MIKAI SPA	KERIFLEX	X
STRYKER ITALIA srl S.U.	SWANSON ARTICOLAZIONE DITO	X

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CORMED SAS	MAIA	X
MIKAI SPA	TOUCH	X
STRYKER ITALIA srl S.U.	MOOVIS	X

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
STRYKER ITALIA srl S.U.	PYROCARDAN	

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	CAPFLEX	X

La seduta si chiude alle 15,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 23/11/2023


Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Marcello FEDERICI




Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO




Componente Commissione Giudicatrice


Dott. Francesco RATTO

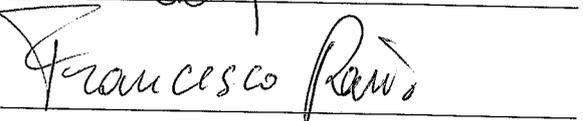

Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1785882
del 14/12/2023

2/2023

Prot. n. NP/2023/1785882

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

2^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 2^ seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 14/12/2023, alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione inizia l'esame della campionatura delle Ditte partecipanti.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede riepilogative dei punteggi di qualità.

Le schede relative ai lotti 3 - 4 - 5 - 13 - 16 - 20 vengono allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. La scheda del lotto 10 verrà allegata al verbale della seduta successiva, nella quale si concluderà la valutazione di tale lotto.

Alle ore 8,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **STRYKER ITALIA SRL S.U.** per i lotti 3 - 4 - 13 - 10 - 16 - 20.

Per la Ditta sono presenti Maurizio Lanzafame e Paolo Vitali.

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

Prodotto offerto: APSI (Adaptative Proximal Scafoid Implant)

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato il prodotto offerto ed illustrata la modalità di utilizzo parziale

Confezione di piccole dimensioni e di facile apertura, chiara etichettatura di tracciabilità

Alle ore 8,57 termina la presentazione.

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

Alle ore 9,01 inizia la presentazione della campionatura del lotto 4

Prodotto offerto: RCPI Impianto in pirocarbonio di resurfacing del capitato

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

La Commissione procede all'analisi del prodotto offerto. Vengono mostrate le componenti di prova.

Confezione di piccole dimensioni e di facile apertura, chiara etichettatura di tracciabilità

Alle ore 9,07 termina la presentazione.

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

Alle ore 9,10 inizia la presentazione della campionatura del lotto 13

Prodotto offerto: LATITUDE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato il prodotto offerto ed il relativo strumentario (3 cassette).

Viene illustrata la tecnica chirurgica

La Commissione prova il prodotto e le relative componenti di prova

Confezione di piccole dimensioni e di facile apertura, chiara etichettatura di tracciabilità.

Impianto solo cementato

Alle ore 9,25 termina la presentazione.

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

Alle ore 9,30 inizia la presentazione della campionatura del lotto 16

Prodotto offerto: SWANSON METATARSOFALANGEA

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto ed esamina il prodotto ed il relativo strumentario nonché le componenti di prova

Alle ore 9,40 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 8 misure per impianti sia destri che sinistri

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti è risultato molto semplice

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario composto da una cassetta; strumentario leggero, maneggevole, semplice, preciso; risulta di facile pulizia e sterilizzazione. Presenza di grommet lisci che aumentano la stabilità dell'impianto

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti codici colore; come serigrafie ci sono solo i numeri delle taglie delle componenti dello strumentario

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova risultano identiche rispetto al prodotto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di piccole dimensioni e di facile apertura, chiara etichettatura di tracciabilità.

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

Alle ore 9,47 inizia la presentazione della campionatura del lotto 20

Prodotto offerto: PYROCARDAN

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto ed esamina il prodotto ed il relativo strumentario nonché le componenti di prova

Alle ore 9,52 termina la presentazione.

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

Alle ore 9,57 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti del lotto 10.


Prodotto offerto: RHS

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto ed esamina il prodotto ed il relativo strumentario nonché le componenti di prova.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Il prodotto offerto presenta n. 5 taglie, 3 diametri e un'altezza

Alle ore 10,10 termina la presentazione.

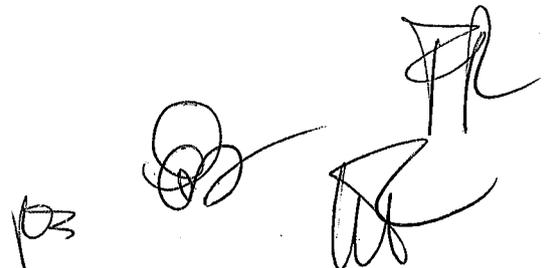

Valutazione del sistema proposto in relazione al disegno dell'impianto

Osservazioni: il disegno prevede un accoppiamento che consente un piccolo range di movimento tra stelo e capitello. La presenza di steli cementati anche di lunghe dimensioni fornisce una pratica soluzione in caso di importante perdita d'osso.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: vengono fornite ampie soluzioni intra-operatorie con anche la possibilità di conversione da non cementato a cementato sul tavolo operatorio. Disponibili steli di molteplici dimensioni, anche lunghi, per trattare fratture non sintetizzabili della regione metadiafisaria. Il capitello radiale viene fornito in 5 diametri e singola altezza e la tensione dell'impianto viene regolata con gli accoppiamenti con il capitello e i diversi colli a disposizione

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il prodotto offerto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Valutazione in ordine al materiale offerto (Q5)

Osservazioni: stelo corto in titanio e stelo lungo cementato cromo cobalto

Possibilità di impianto con o senza cemento (Q5)

Osservazioni: sì

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio; non c'è strumento per disassemblare

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario composto da una cassetta, strumentario preciso, semplice e maneggevole. Unico strumentario per versione cementata e non. Di facile pulizia e sterilizzazione. I diapason forniti per determinare l'altezza del capitello radiale possono fornire una misura poco accurata

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono chiare serigrafie e codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio


Osservazioni: le componenti di prova presentano una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

La parte non cementata è -correttamente- sovra dimensionata rispetto alla prova

Confezionamento

Osservazioni: confezione di piccole dimensioni e facile stoccaggio, di facile apertura, chiara etichettatura di tracciabilità.

*** **

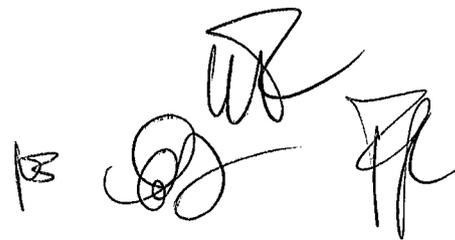

Alle ore 10,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **BRM EXTREMITIES SRL** per il lotto 16.

Per la Ditta sono presenti Giulia Cappoli e Cesare Delbene

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

Prodotto offerto: SILKTOE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto (doppia confezione) ed esamina il prodotto ed il relativo strumentario nonché le componenti di prova.

Strumentario suddiviso per 3 taglie; vengono mostrati: maschera di taglio, raspa, adattatori a motore

Viene illustrata la tecnica chirurgica

Alle ore 10,48 termine la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 10 misure: 5 taglie per ciascuna lateralità (destra e sinistra)

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta molto semplice

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: ottimo il programma formativo proposto. La Ditta dichiara di organizzare, con frequenza assidua, congressi, cavader lab, training o webinar con i maggiori esperti nel campo della ortopedia e traumatologia delle estremità, oltre a corsi per strumentisti, con il nostro personale presso le sale operatorie, per illustrare gli strumentari e le metodologie di impiego ed utilizzo degli impianti.

Dichiara di promuovere inoltre l'attività surgeon-to-surgeon per facilitare la connessione tra ortopedici e ottimizzare al meglio la formazione dei chirurghi interessati ad apprendere gli approcci chirurgici legati ai nostri dispositivi.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario contenuto in una cassetta di ridotte dimensioni e peso contenuto; strumentario molto preciso e di semplice utilizzo. Molto positiva la presenza di grommet zigrinato per una maggiore stabilità dell'impianto. La presenza di guide di taglio dedicate per precisione dell'osteotomie permette un facile utilizzo anche per chirurghi meno esperti

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore; non ci sono serigrafie per facilitare il riassetto dello strumentario ma ci sono alloggiamenti dedicati con indicate le misure delle componenti; la mancanza di serigrafie sul fondo della cassetta è in ogni caso compensata dalla pratica disposizione dei materiali e dai codici riportati accanto ad ogni strumento ed ogni prova


Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova presentano una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di piccole dimensioni ma apertura non particolarmente agevole; chiara etichettatura con codice colore

*** **

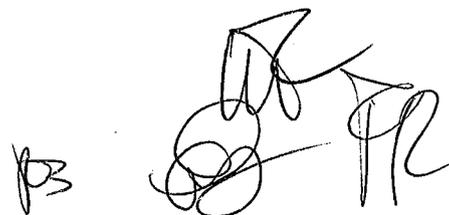

Alle ore 11,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LIMACORPORATE srl** per il lotto 5.

Per la Ditta è presente Antonio Burgio

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

Prodotto offerto: SMR RESURFACING

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto ed esamina il prodotto ed il relativo strumentario (composto da una cassetta) nonché le componenti di prova.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,40 termine la presentazione.

*** **

La Commissione ricorda che ad esito della precedente seduta riservata aveva ritenuto necessario inviare alcune richieste di chiarimenti in merito al possesso di requisiti di minima previsti dal Capitolato e precisamente:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL lotto 9: "avere la parte prossimale riempitiva, un rivestimento adatto e relativi fori per suture al fine di garantire un ottimo riposizionamento e stabilità delle tuberosità"
- PERMEDICA SPA lotti 8 e 9: "presenza di molteplici fori di sutura"
- STRYKER ITALIA SRL S.U. lotti 8 e 9: "presenza di molteplici fori di sutura"

Le predette Ditte hanno fornito riscontro indicando puntualmente i punti della documentazione tecnica ove sono rinvenibili i requisiti *de quibus*.

La Commissione esamina i riscontri pervenuti e ritiene che i prodotti offerti dalle predette Ditte nei lotti sopra citati rispettino i requisiti di minima previsti dal Capitolato tecnico.

La Commissione procede a questo punto a svolgere attività istruttoria leggendo la documentazione tecnica degli altri lotti che saranno valutati nelle successive sedute al fine di estrapolare i dati che saranno oggetto di valutazione tramite criteri oggettivi (Q3 e Q5).

*** **

La seduta si chiude alle 13,00

Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi dei lotti 3 - 4 - 5 - 13 - 16 - 20

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 14/12/2023

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Marcello FEDERICI




Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO



Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Francesco RATTO



Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.				
3 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,5	Dott. Marcello Federici	15,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B4	0,500	MAX tra le medie
4 - Identificazione dei componenti	10	0,5	Dott. Marcello Federici	10,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B5	0,500	MAX tra le medie
5 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	15	0,5	Dott. Marcello Federici	15,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B5	0,500	MAX tra le medie
6 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000		
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,7	Dott. Francesco Ratto			
		0,700	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B7	0,700	MAX tra le medie

103

[Handwritten signatures and initials]

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261**

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
2 - Numero di misure, destre e sinistre, disponibili	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
STRYKER ITALIA srl S.U.	3 15,000 0,000
Valore Max	3
Base d'asta	3

Flaminio ¹⁰²



**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261**

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

CRITERIO DI VALUTAZIONE			
1 - Possibilità di utilizzo anche con protesi parziale			
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note
STRYKER ITALIA srl S.U.	10,000	10,000	

Flavio  


**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.
Possibilità di utilizzo anche con protesi parziale	Q5	10	10,000
Numero di misure, destre e sinistre, disponibili	Q3	15	0,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	15	15,000
Identificazione dei componenti	Q1	10	10,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	15	15,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			55,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000




 b3

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.				
2 - Efficienza nell'utilizzo	20	0,5	Dott. Marcello Federici	20,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B4	0,500	MAX tra le medie
3 - Identificazione dei componenti	10	0,5	Dott. Marcello Federici	10,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B5	0,500	MAX tra le medie
4 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	15	0,5	Dott. Marcello Federici	15,000		
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B5	0,500	MAX tra le medie
5 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000		
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,7	Dott. Francesco Ratto			
		0,700	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
				B7	0,700	MAX tra le medie

Flavio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261**

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

CRITERIO DI VALUTAZIONE				
1 - Numero di misure, destre e sinistre, disponibili				
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
STRYKER ITALIA srl S.U.	2	20,000	0,000	
Valore Max	2			
Base d'asta	2			

Flavio
AD
AD

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.
Numero di misure, destre e sinistre, disponibili	Q3	20	0,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	20	20,000
Identificazione dei componenti	Q1	10	10,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	15	15,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			50,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000

Flavio

UR

P

SB

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	LIMACORPORATE srl					
3 - Efficienza nell'utilizzo	20	0,7	Dott. Marcello Federici	20,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
4 - Identificazione dei componenti	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
5 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
6 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				

Floris

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
2 - Numero di taglie disponibili	
DITTE	
LIMACORPORATE srl	
Valore	Peso Parametro
11	15,000
Punteggio	Note
15,000	
Valore Max	11
Base d'asta	6

Flavio

WA

to

[Signature]

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261**

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

CRITERIO DI VALUTAZIONE			
1 - Possibilità di utilizzo di teste versione CTA			
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note
LIMACORPORATE srl	10,000	10,000	

Handwritten signatures:
Three distinct signatures in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	LIMACORPORATE srl
Possibilità di utilizzo di teste versione CTA	Q5	10	10,000
Numero di taglie disponibili	Q3	15	15,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	20	20,000
Identificazione dei componenti	Q1	10	10,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	10	10,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A large signature, possibly "Flavio".
 - Middle left: The number "13".
 - Middle right: A large signature.
 - Bottom right: A circular stamp or signature.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.				
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	12	0,5	Dott. Marcello Federici	12,000	B4	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
2- Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	12	0,5	Dott. Marcello Federici	12,000	B5	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
4 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,5	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
5 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,5	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
6 - Efficienza nell'utilizzo	14	0,5	Dott. Marcello Federici	14,000	B4	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
7 - Identificazione dei componenti	5	0,5	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
8 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	7	0,5	Dott. Marcello Federici	7,000	B5	0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,5	Dott. Francesco Ratto			
		0,500	MEDIA			
		1,000	COEFF.			
9 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo			
		0,7	Dott. Francesco Ratto			
		0,700	MEDIA			
		1,000	COEFF.			

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

CRITERIO DI VALUTAZIONE			
3 - Possibilità di impianto con o senza cemento			
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note
STRYKER ITALIA srl S.U.	5,000	0,000	

AS

Fland
Bel

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	Q1	12	12,000
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	Q1	12	12,000
Possibilità di impianto con o senza cemento	Q5	5	0,000
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	5	5,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5	5,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	14	14,000
Identificazione dei componenti	Q1	5	5,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	7	7,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			65,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000

CR
P3

Fland
Boff

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE
 MEDICALE (CIG 9830983FCD)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	BRM EXTREMITIES s.r.l.	STRYKER ITALIA s.r.l.	
2 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	10	0,7 Dott. Marcello Federici	0,7 Dott. Marcello Federici	B4 0,700 MAX tra le medie
		0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		0,7 Dott. Francesco Ratto	0,7 Dott. Francesco Ratto	
		10,000	10,000	
		0,700 MEDIA	0,700 MEDIA	
		1,000 COEFF.	1,000 COEFF.	
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,7 Dott. Marcello Federici	0,7 Dott. Marcello Federici	B5 0,700 MAX tra le medie
		0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		0,7 Dott. Francesco Ratto	0,7 Dott. Francesco Ratto	
		5,000	5,000	
		0,700 MEDIA	0,700 MEDIA	
		1,000 COEFF.	1,000 COEFF.	
4 - Efficienza nell'utilizzo	15	1 Dott. Marcello Federici	0,7 Dott. Marcello Federici	B7 1,000 MAX tra le medie
		1 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		1 Dott. Francesco Ratto	0,7 Dott. Francesco Ratto	
		15,000	10,500	
		1,000 MEDIA	0,700 MEDIA	
		1,000 COEFF.	0,700 COEFF.	
5 - Identificazione dei componenti	10	0,7 Dott. Marcello Federici	0,5 Dott. Marcello Federici	B7 0,700 MAX tra le medie
		0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		0,7 Dott. Francesco Ratto	0,5 Dott. Francesco Ratto	
		10,000	7,143	
		0,700 MEDIA	0,500 MEDIA	
		1,000 COEFF.	0,714 COEFF.	
6 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	0,7 Dott. Marcello Federici	0,7 Dott. Marcello Federici	B7 0,700 MAX tra le medie
		0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		0,7 Dott. Francesco Ratto	0,7 Dott. Francesco Ratto	
		10,000	10,000	
		0,700 MEDIA	0,700 MEDIA	
		1,000 COEFF.	1,000 COEFF.	
7 - Confezionamento	5	0,5 Dott. Marcello Federici	0,7 Dott. Marcello Federici	B7 0,700 MAX tra le medie
		0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo	
		0,5 Dott. Francesco Ratto	0,7 Dott. Francesco Ratto	
		3,571	5,000	
		0,500 MEDIA	0,700 MEDIA	
		0,714 COEFF.	1,000 COEFF.	

Mano

AS

B

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)		CRITERIO DI VALUTAZIONE			
		1 - Numero misure impianto			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note	
BRM EXTREMITIES srl.	10	15,000	15,000		
STRYKER ITALIA srl S.U.	8	15,000	10,714		
Valore Max				10	
Base d'asta				3	

Flavio

UR

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Numero misure impianto	15	Q3
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	10	Q1
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1
Efficienza nell'utilizzo	15	Q1
Identificazione dei componenti	10	Q1
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	Q1
Confezionamento	5	Q1

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

BRM EXTREMITIES srl
15,000
10,000
5,000
15,000
10,000
10,000
3,571
68,571
70,000

STRYKER ITALIA srl S.U.
10,714
10,000
5,000
10,500
7,143
10,000
5,000
58,357
59,573

Floris

UR

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.			
2 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	10	0,5	Dott. Marcello Federici	10,000	B4 0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,5	Dott. Francesco Ratto		
		0,500	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,5	Dott. Marcello Federici	5,000	B5 0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,5	Dott. Francesco Ratto		
		0,500	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
4 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,7	Dott. Marcello Federici	15,000	B4 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
5 - Identificazione dei componenti	10	0,5	Dott. Marcello Federici	10,000	B5 0,500 MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,5	Dott. Francesco Ratto		
		0,500	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
6 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B5 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
7 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		

13

Handwritten signature: Dapelo

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
1 - Numero di misure impianto	
DITTE	
STRYKER ITALIA srl S.U.	
Valore	Peso Parametro
7	15,000
Punteggio	Note
15,000	
Valore Max	7
Base d'asta	3


Handwritten signatures and initials:
 1. A stylized signature with the number "13" written above it.
 2. A signature that appears to read "F. Pianta" with a large flourish underneath.

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"
N° gara 9103261**

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA srl S.U.
Numero di misure impianto	Q3	15	15,000
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	10	10,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5	5,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	15	15,000
Identificazione dei componenti	Q1	10	10,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	10	10,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			70,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000

03  



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
 Prot-2023-1866707
 del 21/12/2023

2/2023

Prot. n. NP/2023/1866707

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
 tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

3^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 3^ seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 21/12/2023, alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione inizia l'esame della campionatura delle Ditte partecipanti.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri de quibus vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 8,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **3D SYSTEM SRL** per il lotto 6.

Per la Ditta è presente Massimo De Cristoforo

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

Prodotto offerto: FX Solutions

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 8,54 termine la presentazione.

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente una buona varietà di soluzioni intra-operatorie, anche di conversione dell'impianto in corso d'opera. Si rileva tuttavia che è possibile passare da anatomica a inversa solo con il taglio a 135°

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema presenta un'ottima bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: il programma formativo proposto risulta molto preciso e dettagliato, con indicazione precisa di programma, sedi, durata, cadenza.

La formazione può avvenire on site direttamente presso la struttura, con incontri formativi sulla base delle esigenze specifiche, concordando modalità, tempi e contenuti con il Direttore di Struttura o un Suo incaricato. Sono previsti altresì momenti di confronto e discussione con presentazione di casi clinici e sessioni pratiche, in genere su sawbones, WORKSHOP, DEMO SURGERY e CADAVER LAB presso centri di riferimento italiani ed internazionali, WET-LAB presso l'ICLO di Verona, product Trainings. Si prevedono inoltre corsi avanzati per chirurghi già esperti nell'utilizzo degli strumenti e degli impianti proposti, con cadenza biennale, della durata di 6 ore distribuite su due giornate lavorative, presso strutture autorizzate (sawbone) e corsi di aggiornamento due volte l'anno

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta molto semplice

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì



Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario contenuto in una cassetta; all'interno della cassetta le componenti non risultano facilmente identificabili perché collocate molto vicine tra loro. Strumentario preciso e maneggevole, di facile di pulizia e sterilizzazione. Guida di taglio stabile e precisa

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie chiare e ben leggibili e codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova presenti forniscono una buona rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio, tuttavia manca la possibilità di una simulazione completa dell'impianto definitivo (ad esempio, la componente metaepifisaria deve essere impiantata o va provato connettore e testa senza la componente metaepifisaria)

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura molto agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 9,10 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA S.R.L** per il lotto 6.

Per la Ditta è presente Simon Iacopino

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

Prodotto offerto: ECLIPSE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da un cestello e due vassoi.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 9,20 termine la presentazione.

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto fornisce un'adeguata varietà di soluzioni intra-operatorie ma consente solo la versione anatomica

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli



Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: molto scarna la descrizione del programma formativo proposto dal punto di vista dei relativi contenuti, strumenti e cadenza. Nel programma di apprendimento e aggiornamento per gli operatori sanitari vengono genericamente previsti corsi di formazione e aggiornamento, sia didattici che pratici, corsi di qualificazione tecnica di indirizzo generale sull'uso dei prodotti offerti che potranno svolgersi direttamente in loco, corso di formazione iniziale didattico-scientifico corredato da manuali d'uso per l'operatore e supportato dalla presenza del Product Specialist.
Non è indicato un calendario di formazione e non vengono menzionati corsi cadaver lab.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: no

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo, di facile utilizzo, maneggevole, contenuto in una cassetta; il taglio non è vincolato dalla mascherina ma solo dal posizionamento di due fili di kirschner

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie non chiare, non ci sono codici colore.

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e quindi facile stoccaggio. Apertura poco agevole. Chiara etichettatura

*** **

Alle ore 9,50 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** per il lotto 6.

Per la Ditta sono presenti Mauro Bonaria e Erica Fioritto

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)


Prodotto offerto: Global Icon

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette in un unico container.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 10,15 termine la presentazione.

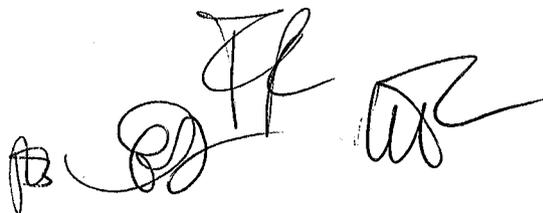

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente una molteplicità di soluzione intraoperatorie grazie a diverse misure e diversi offset

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto ha notevole bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa viene valutata in maniera eccellente dalla Commissione. La Ditta descrive in maniera molto puntuale e dettagliata le tipologie di corsi proposti (Corsi teorici di teleosservazione da remoto – Webinar, Corsi teorico-pratici residenziali – In-hospital training, Corsi teorico-pratici con sessioni dry-lab, Corsi teorico-pratici con sessioni cadaver- lab (su preparati anatomici), Corsi pratici in sala operatoria (Preceptorship - Live Observation Case su richiesta, Proctorship (o Flying Surgeon) nonché le tecnologie e gli strumenti impiegati per la formazione (Telementoring con tecnologia smart glasses, Remote Learning: webinar e virtual classes, e-Learning: Johnson&Johnson Institute website On-Demand and Tailored Learning, simulatore artroscopico, piattaforma online per Laparoscopia, Virtual Reality, J-BOX), che risultano molto validi. Viene altresì illustrato un “programma – tipo” di formazione, con precisa indicazione di tempistiche, strumenti, docenti, argomenti.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti presentano un'elevata facilità di assemblaggio e disassemblaggio

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: no

Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: no

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: no. La componente di ancoraggio omerale e la componente metaepifisaria sono monoblocco

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario contenuto in un container con due cassette. Strumentario molto preciso e di facile utilizzo. Manici ergonomici antiscivolo, molto maneggevoli e facili da assemblare. Grande varietà di possibilità di tecniche di osteotomia variabili a seconda delle attitudini del chirurgo. La maschera di taglio non vincola la sega per l'osteotomia ma è comunque precisa e fornisce sufficiente protezione della regione metafisaria

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie molto chiare e codici colore. È inoltre riportata una dicitura che identifica lo strumento

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di dimensioni ridotte e facile stoccaggio e facile apertura, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 10,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LIMACORPORATE** per i lotti 6 - 12.

Per la Ditta sono presenti Antonio Burgio e Corrado Villa

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

Prodotto offerto: SMR

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 10,55 termine la presentazione.

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente una varietà molto ampia di soluzioni intra-operatorie, in quanto presenta diverse varietà di impianto, esistono anche connettori eccentrici

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta molto bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa non viene descritta in alcun documento dell'offerta tecnica, pertanto risulta non valutabile.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti presentano un'ottima facilità di assemblaggio e disassemblaggio

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: sì



Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: due cassette di strumentario. Strumentario molto completo, preciso, maneggevole. Possibilità di allineamento endomidollare, maschere di taglio per guidare con precisione la lama. C'è la possibilità di misurare la distanza dell'osteotomia dalla corticale laterale per scegliere la corretta dimensione dell'impianto. Di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie molto chiare e codici colore per le misure

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, di facile apertura, chiara etichettatura

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

Alle ore 11,10 inizia la presentazione

Prodotto offerto: DISCOVERY

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,30 termina la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto presenta soluzioni adeguate alle richieste del capitolato

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta sufficiente bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Possibilità di impianto con o senza cemento (Q5)

Osservazioni: no, è solo cementata

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa non viene descritta in alcun documento dell'offerta tecnica, pertanto risulta non valutabile.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: due cassette. Strumentario con poche componenti ma completo, molto semplice, maneggevole. Possibilità di strumentario dedicato a misure extra piccole. Di facile pulizia e sterilizzazione



Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie ma non molto chiare e visibili. Ci sono codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio. Ci sono due lunghezze diverse delle componenti di prova, tre misure, destre e sinistre

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, di facile apertura, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 12,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LINK ITALIA** per il lotto 6.

Per la Ditta sono presenti Alessandro Cristini e Luca Giovenzana

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

Prodotto offerto: EMBRACE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da tre cassette: un general set, una per la gabbietta ovale e stellina; una per le prove dell'anatomica. Vengono mostrati gli adattatori (4).

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 12,25 termina la presentazione.

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente varie soluzioni intra-operatorie, doppia possibilità di ancoraggio omerale, possibilità di conversione anatomica, inversa e CTA

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli. Risulta un po' invasiva la guida endomidollare

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: nel Modello M5 bis "questionario tecnico" la Ditta attesta "Corsi di formazione specifici presso l'accademia LINKademy™ ad Amburgo presso la casa produttrice WALDEMAR LINK GmbH & Co. Programmi di formazione on site e momenti formativi integrativi come presentato nel dettaglio nel documento allegato". Nella busta tecnica non viene peraltro allegato alcun altro documento relativo alla proposta formativa, la quale risulta pertanto non valutabile.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio.

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì



Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: tre cassette. Strumentario completo, pratico, manici sufficientemente ergonomici, di facile pulizia e sterilizzazione. L'osteotomia non è guidata da una mascherina di taglio ma solo in appoggio sullo strumento dedicato. C'è la possibilità di misurare la distanza dell'osteotomia dalla corticale laterale per scegliere la corretta dimensione dell'impianto

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie le quali tuttavia risultano poco chiare e poco leggibili essendo sullo sfondo di un cestello traforato. Non ci sono codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura. Apertura molto agevole perché la confezione presenta una chiara indicazione del punto di apertura.

*** **

La seduta si interrompe dalle 13,15 alle 13,45 per la pausa pranzo.

Alle ore 13,50 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.** per i lotti 6 - 10 - 12.

Per la Ditta sono presenti Alfredo De Stefanis e Davide Bagnasco

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

Prodotto offerto: Comprehensive® Total Shoulder System

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto.

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette, una per preparazione la omerale divisa per codice colore in base alle misure, l'altra con le teste omerali di prova.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 14,05 termina la presentazione.

Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard (Q5)

Osservazioni: sì

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente un'ampia varietà di soluzioni intra-operatorie; positivo che con un'unica componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale vengano garantite diverse soluzioni per modificare l'offset dell'impianto

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli
Osservazioni: il sistema proposto consente un'ottima bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto dettagliata il programma formativo proposto, gli strumenti utilizzati e le relative modalità. Non viene fornita una calendarizzazione

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: si

Possibilità di versione inversa (Q5)

Osservazioni: no

Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: due cassette. Strumentario completo, preciso, semplice. Tutta la strumentazione è cannulata; è presente una massa battente per la rimozione, uno specifico strumento di rimozione per l'ancora e per il disaccoppiamento tra le componenti in caso di montaggio errato. Le guide di taglio omerali sono precise nel posizionamento ma non proteggono la regione metafisaria

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie non particolarmente chiare essendo sullo sfondo di un cestello traforato; sono presenti codice colore in base alle misure delle componenti dello strumentario

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio. C'è la possibilità di provare tutte le componenti. Molto positivo il fatto che c'è la possibilità di modificare per ogni testa l'eccentricità

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura, apertura agevole

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

Alle ore 14,20 inizia la presentazione della campionatura del lotto 10

Prodotto offerto: Explor®

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto.

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 14,27 termine la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione al disegno dell'impianto

Osservazioni: sistema anatomico con un adeguato numero di misure per soddisfare le diverse conformazioni anatomiche dei pazienti; l'accoppiamento tra stelo e testa risulta fisso e stabile



Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto offre un'ampia varietà di possibilità per il ripristino dell'anatomia del gomito; a parità di diametro della testa offre più soluzioni per variare l'altezza del capitello

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il disegno anatomico è rispettoso dei tessuti molli e del tessuto osseo, risulta efficace nel risparmio osseo

Valutazione in ordine al materiale offerto (Q5)

Osservazioni: titanio e cromo-cobalto

Possibilità di impianto con o senza cemento (Q5)

Osservazioni: sì

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio; stesso strumento per assemblaggio e disassemblaggio

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto dettagliata il programma formativo proposto, gli strumenti utilizzati e le relative modalità. Non viene fornita una calendarizzazione

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta. Strumentario molto semplice, intuitivo, maneggevole, di facile pulizia e sterilizzazione. Manico a "s", facile da maneggiare e mini invasivo. Unico strumentario per versione cementata e non.

Lo strumentario permette, con l'utilizzo degli stessi strumenti e delle stesse componenti di prova, di scegliere sul campo operatorio tra versione cementata e non.

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie chiare e ben leggibili e codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova presentano una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio. L'assemblaggio delle componenti di prova è molto stabile, il che è importante nella valutazione della stabilità dell'articolazione

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura, apertura agevole

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

Alle ore 14,42 inizia la presentazione della campionatura del lotto 12

Prodotto offerto: NEXEL

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto.

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette per l'impianto e una cassetta dedicata a rimozione e revisione della protesi

Viene illustrata la tecnica chirurgica.



Alle ore 15,05 termina la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto presenta buona varietà di soluzioni intra-operatorie. Positiva la disponibilità di due misure della flangia anteriore della componente omerale, utile in casi di fratture con maggior estensione meta-difiasaria

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta sufficiente bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Possibilità di impianto con o senza cemento (Q5)

Osservazioni: no, impianto solo cementato

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio; non facile disassemblaggio perché ci sono più componenti.

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto dettagliata il programma formativo proposto, gli strumenti utilizzati e le relative modalità. Non viene fornita una calendarizzazione

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario composto da due cassette per l'impianto e una cassetta dedicata a rimozione e revisione della protesi. Strumentario molto completo e molto preciso; molto positivo il fatto che siano previsti strumenti per il trattamento delle fratture intra-operatorie. Ci sono alesatori di vari diametri; c'è una pinza e due piccoli battitori per l'assemblaggio della protesi definitiva; cacciavite monouso. Diverse tipi di frese sia cannulate che non cannulate

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie molto chiare e visibili; non ci sono codici colore ma le misure delle componenti di prova sono molto ben segnalate e leggibili

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio.

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura, apertura agevole.


*** **

Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi dei lotti 6 - 10 - 12

La seduta si chiude alle 15,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 21/12/2023

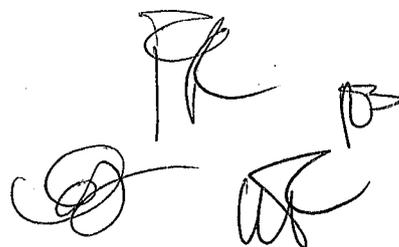

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Marcello FEDERICI

Marcello Federici

Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO

Emanuela Dapelo

Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Francesco RATTO

Francesco Ratto

Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Rossana Brandolin

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG
 9830382FD7)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	3D SYSTEM SRL	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LIMACORPORATE	LINK ITALIA	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.		
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni Intraoperatorie consentite	8	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	84	1,000 MAX tra le medie
3 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	8	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	85	0,700 MAX tra le medie
4 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	85	1,000 MAX tra le medie
5 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	85	0,700 MAX tra le medie
9 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	87	1,000 MAX tra le medie
10 - Identificazione dei componenti	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	87	1,000 MAX tra le medie
11 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	5	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	87	1,000 MAX tra le medie
12 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	87	1,000 MAX tra le medie

Floris



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261	CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
	1 - Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard		6 - Componenti anallergiche		7 - Possibilità di versione inversa		8 - Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale	
LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)								
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio
3D SYSTEM SRL	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ARTHREX ITALIA S.R.L	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	8,000	8,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
LIMACORPORATE	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
LINK ITALIA	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000

Florio



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID	3D SYSTEM SRL	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LIMACORPORATE	LINK ITALIA	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
Possibilità di convertire la componente omerale ad una protesi standard	8	Q5	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	8	Q1	4,000	2,400	5,600	5,600	8,000	5,600
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	8	Q1	8,000	8,000	8,000	8,000	5,714	8,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1	5,000	1,500	5,000	0,000	0,000	3,500
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	Q1	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Componenti anallergiche	2	Q5	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	2,000
Possibilità di versione inversa	2	Q5	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000
Presenza di componente meta-epifisaria di accoppiamento tra ancoraggio e testa omerale	2	Q5	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	2,000
Efficienza nell'utilizzo	15	Q1	7,500	10,500	15,000	10,500	7,500	10,500
Identificazione dei componenti	5	Q1	5,000	1,500	5,000	5,000	1,500	3,500
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	Q1	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000
Confezionamento	5	Q1	3,500	2,500	3,500	3,500	5,000	3,500
TOTALE PUNTEGGIO			54,500	46,900	58,600	55,100	50,214	56,600
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			65,102	56,024	70,000	65,819	59,983	67,611

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: "P. Rad..."
 - Middle signature: "P." with a flourish
 - Right signature: "W" with a flourish
 - Bottom signature: "S" with a flourish

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	STRYKER ITALIA s.r.l.		ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.				
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione al disegno dell'impianto	10	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	7,143	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	10,000	B4	0,700	MAX tra le medie
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	10	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	10,000	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	10,000	B5	0,700	MAX tra le medie
3 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	7	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	7,000	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	7,000	B7	0,700	MAX tra le medie
6 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	3,571	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
7 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	B5	0,700	MAX tra le medie
8 - Efficienza nell'utilizzo	10	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	7,143	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	10,000	B7	0,700	MAX tra le medie
9 - Identificazione dei componenti	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	B7	1,000	MAX tra le medie
10 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	3,500	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	B7	1,000	MAX tra le medie
11 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000	B7	0,700	MAX tra le medie

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari"
 LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

	CRITERIO DI VALUTAZIONE			CRITERIO DI VALUTAZIONE		
	4 - Valutazione in ordine al materiale offerto			5 - Possibilità di impianto con o senza cemento		
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note	Peso Parametro	Punteggio	Note
STRYKER ITALIA S.p.A.	3,000	3,000		5,000	5,000	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	3,000	3,000		5,000	5,000	

Titanio cromo-cobalto punti 3

Acciaio punti 1

AR

Thais
Enche

P

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Valutazione del sistema proposto in relazione al disegno dell'impianto	10	Q1
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	10	Q1
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	7	Q1
Valutazione in ordine al materiale offerto	3	Q5
Possibilità di impianto con o senza cemento	5	Q5
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	Q1
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1
Efficienza nell'utilizzo	10	Q1
Identificazione dei componenti	5	Q1
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	5	Q1
Confezionamento	5	Q1

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

STRYKER ITALIA srl S.U.
7,143
10,000
7,000
3,000
5,000
3,571
5,000
7,143
5,000
3,500
5,000
61,357
61,357

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
10,000
10,000
7,000
3,000
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
70,000
70,000





Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	LIMACORPORATI	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni Intra-operatorie consentite	12	0,1 Dott. Marcello Federici 0,1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,1 Dott. Francesco Ratto 0,100 MEDIA 0,200 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 1,000 COEFF.	12,000
		2,400		12,000
				85 0,500 MAX tra le medie
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	12	0,1 Dott. Marcello Federici 0,1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,1 Dott. Francesco Ratto 0,100 MEDIA 1,000 COEFF.	0,1 Dott. Marcello Federici 0,1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,1 Dott. Francesco Ratto 0,100 MEDIA 1,000 COEFF.	12,000
		12,000		12,000
				87 0,100 MAX tra le medie
4 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	3,571
		5,000		3,571
				84 0,700 MAX tra le medie
5 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000
		0,000		5,000
				85 0,700 MAX tra le medie
6 - Efficienza nell'utilizzo	14	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	14,000
		9,800		14,000
				87 1,000 MAX tra le medie
7 - Identificazione dei componenti	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000
		5,000		5,000
				87 0,700 MAX tra le medie
8 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	7	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	7,000
		7,000		7,000
				87 0,700 MAX tra le medie
9 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	5,000
		5,000		5,000
				87 0,700 MAX tra le medie

WR

F. P. P. P.
 P. P. P. P.

103

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

CRITERIO DI VALUTAZIONE			
3 - Possibilità di impianto con o senza cemento			
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note
LIMACORPORATE	5,000	0,000	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	5,000	0,000	



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	12	Q1
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	12	Q1
Possibilità di impianto con o senza cemento	5	Q5
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	Q1
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1
Efficienza nell'utilizzo	14	Q1
Identificazione dei componenti	5	Q1
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	7	Q1
Confezionamento	5	Q1


TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

LIMACORPORATE
2,400
12,000
0,000
5,000
0,000
9,800
5,000
7,000
5,000
46,200
50,872

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
12,000
12,000
0,000
3,571
5,000
14,000
5,000
7,000
5,000
63,571
70,000





REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0034664
del 11/01/2024

Genova, 11/01/2024

Prot. n. NP/2024/0034664

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

4[^] SEDUTA RISERVATAVerbale 4[^] seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 11/01/2024, alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 "Savonese"	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione inizia l'esame della campionatura delle Ditte partecipanti.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 8,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ARTHREX ITALIA SRL** per il lotto 7.

Per la Ditta è presente Simon Iacopini.

Prodotto offerto: UNIVERS APEX HUMERAL STEM

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette. Viene tuttavia portata in visione solo una cassetta.

Viene illustrata la pianificazione digitale relativa all'impianto e la tecnica chirurgica.

Alle ore 8,55 termine la presentazione.

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto offre la possibilità di cambiare inclinazione, ma la variabilità dei gradi di versione è limitata

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto risulta poco invasivo

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: molto scarna la descrizione del programma formativo proposto dal punto di vista dei relativi contenuti, strumenti e cadenza. Nel programma di apprendimento e aggiornamento per gli operatori sanitari vengono genericamente previsti corsi di formazione e aggiornamento, sia didattici che pratici, corsi di qualificazione tecnica di indirizzo generale sull'uso dei prodotti offerti che potranno svolgersi direttamente in loco, corso di formazione iniziale didattico-scientifico corredato da manuali d'uso per l'operatore e supportato dalla presenza del Product Specialist.

Non è indicato un calendario di formazione e non vengono menzionati corsi cadaver lab

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio; la Commissione rileva tuttavia che non è a disposizione una prova della protesi con possibilità di correggere inclinazione dell'impianto

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)


Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: no

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario composto da due cassette; strumentario semplice, maneggevole; è stata però portata in visione solo una broccia per la preparazione della metafisi omerale e non la cassetta completa.

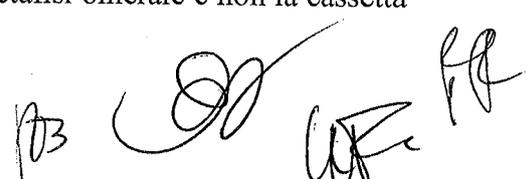

Identificazione dei componenti

Osservazioni: serigrafie molto chiare e ben rappresentate; non ci sono codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: non è possibile assemblare le componenti definitive sulla base di quanto misurato con le componenti di prova (non sono presenti indici di antiversione retroversione inclinazione sulle prove)

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

Alle ore 9,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti per il lotto 8.

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Prodotto offerto: UNIVERS REVERS HUMERAL STEM

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da tre cestelli per l'impianto ed uno per la rimozione della glena.

Viene illustrata la pianificazione digitale

Viene mostrato lo stelo, la coppa omerale

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 9,30 termine la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: protesi solo inversa; buona varietà di soluzioni intra-operatorie consentite, tramite un adattatore può diventare CTA

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il fittone centrale della base plate non è di ridotte dimensioni quindi non risulta di bassa invasività

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: molto scarna la descrizione del programma formativo proposto dal punto di vista dei relativi contenuti, strumenti e cadenza. Nel programma di apprendimento e aggiornamento per gli operatori sanitari vengono genericamente previsti corsi di formazione e aggiornamento, sia didattici che pratici, corsi di qualificazione tecnica di indirizzo generale sull'uso dei prodotti offerti che potranno svolgersi direttamente in loco, corso di formazione iniziale didattico-scientifico corredato da manuali d'uso per l'operatore e supportato dalla presenza del Product Specialist.


Non è indicato un calendario di formazione e non vengono menzionati corsi cadaver lab

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica risulta una buona facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

103  

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: no

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell'inserto (Q5)

Osservazioni: sì

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: tre cestelli per l'impianto ed uno per la rimozione della glena; le componenti non risultano di semplice utilizzo perché hanno vari step di regolazione e non è presente il corrispettivo tra le prove e l'impiantabile come codice colore; sufficiente maneggevolezza

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore per la lunghezza delle viti periferiche e serigrafie molto chiare

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova permettono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 9,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** per i lotti 7 - 8 - 9. Il sistema offerto in tali lotti è il medesimo. Per la Ditta sono presenti Mauro Bonaria e Chiara Villa

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Prodotto offerto: DELTA XTEND

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da tre cassette


Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Protesi cementata (monoblocco) e non cementata (possibilità di vedere diametro canale, misurare epifisi)

Alle ore 10,24 termina la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema consente varie soluzioni intra operatorie consentite; si segnala tuttavia che il sistema vincola all'utilizzo di uno stelo cementato qualora il chirurgo ritenesse necessaria la sutura delle tuberosità

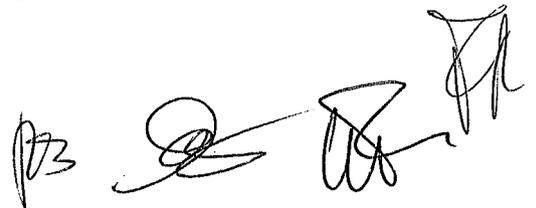

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; si rileva tuttavia che il base plate è rotondo, non corrispondente quindi alla forma anatomica della glena

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa viene valutata in maniera eccellente dalla Commissione. La Ditta descrive in maniera molto puntuale e dettagliata le tipologie di corsi proposti (Corsi teorici di teleosservazione da remoto – Webinar, Corsi teorico-pratici residenziali – In-hospital training, Corsi teorico-pratici con sessioni dry-lab, Corsi teorico-pratici con sessioni cadaver- lab (su preparati anatomici), Corsi pratici in sala operatoria (Preceptorship - Live Observation Case su richiesta, Proctorship (o Flying Surgeon) nonché le tecnologie e gli strumenti impiegati per la formazione (Telementoring con tecnologia smart glasses, Remote Learning: webinar e virtual classes, e-Learning: Johnson&Johnson Institute website On-Demand and Tailored Learning, simulatore artroscopico, piattaforma online per Laparoscopia, Virtual Reality, J-BOX), che risultano molto validi. Viene altresì illustrato un “programma – tipo” di formazione, con precisa indicazione di tempistiche, strumenti, docenti, argomenti.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: eccellente facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti perché guidato da viti di assemblaggio

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: no

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell'inserto (Q5)

Osservazioni: no

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario suddiviso in tre cassette, molto completo (l'elevato numero di componenti è legato alla varietà di soluzioni intra operatorie), maneggevole, preciso, di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: non ci sono codici colore, sono presenti serigrafie

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova consentono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio.



Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

Alle ore 10,45 inizia la presentazione della campionatura dei lotti 7 e 9. Il sistema offerto in tali lotti è il medesimo

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario

Viene illustrata la tecnica chirurgica

Alle ore 11 termina la presentazione

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: gamma molto ampia di soluzioni intra operatorie consentite

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa viene valutata in maniera eccellente dalla Commissione. La Ditta descrive in maniera molto puntuale e dettagliata le tipologie di corsi proposti (Corsi teorici di teleosservazione da remoto – Webinar, Corsi teorico-pratici residenziali – In-hospital training, Corsi teorico-pratici con sessioni dry-lab, Corsi teorico-pratici con sessioni cadaver- lab (su preparati anatomici), Corsi pratici in sala operatoria (Preceptorship - Live Observation Case su richiesta, Proctorship (o Flying Surgeon) nonché le tecnologie e gli strumenti impiegati per la formazione (Telementoring con tecnologia smart glasses, Remote Learning: webinar e virtual classes, e-Learning: Johnson&Johnson Institute website On-Demand and Tailored Learning, simulatore artroscopico, piattaforma online per Laparoscopia, Virtual Reality, J-BOX), che risultano molto validi.

Viene altresì illustrato un “programma – tipo” di formazione, con precisa indicazione di tempistiche, strumenti, docenti, argomenti.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta molto semplice

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)


Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: no nel sistema base offerto, disponibilità solo custom made

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario composto da 3 cassette per ogni tipologia di situazione (elezione o trauma); strumentario molto completo, maneggevole, preciso; elevato numero di componenti stante l'elevata gamma di soluzioni intraoperatorie consentite

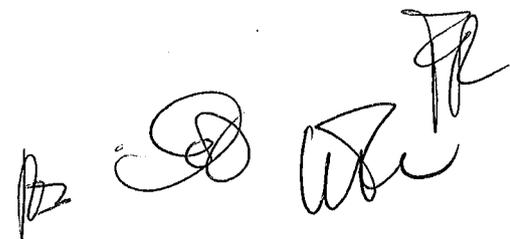

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore e serigrafie molto chiare e ben leggibili

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: chiare, hanno il codice colore, consentono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 11,15 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LIMACORPORATE** per i lotti 7 - 8 - 9. Il prodotto offerto in tali lotti è il medesimo
Per la Ditta sono presenti Antonio Burgio, Corrado Villa, Michele Cazzaniga e Consuelo Allegretta

Prodotto offerto: SMR

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario. Quello base è composto da 5 cassette, a seconda dell'intervento. C'è uno strumentario comune che ha gli steli di prova; vengono quindi mostrate le varie cassette che bisogna utilizzare a seconda della tipologia di intervento.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,50 termina la presentazione.

Durante la presentazione della campionatura emerge la mancanza del requisito della presenza di viti che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale per il fissaggio della metaglena. Considerato che trattasi di requisito previsto dal Capitolato a pena di esclusione nei lotti 8 e 9, la Commissione si riserva di meglio esaminare la documentazione tecnica relativa a tali lotti in successiva seduta riservata; decide pertanto di rinviare l'attribuzione dei punteggi per i lotti 8 e 9 all'esito di tale ulteriore valutazione.

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite


Osservazioni: amplissima varietà di soluzioni intra-operatorie. Il sistema consente di correggere in corso d'opera il tipo di impianto, basandosi sulle necessità e consente di trovare soluzioni rapide ed efficaci in caso di variazioni del programma operatorio

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il design degli impianti permette di risparmiare tessuto osseo e lo strumentario consente un eccellente rispetto dei tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: la proposta formativa non viene descritta in alcun documento dell'offerta tecnica, pertanto risulta non valutabile.

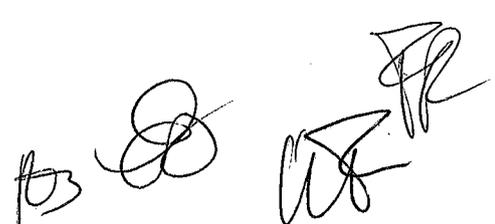

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica risulta un'eccellente facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti grazie a uno strumento filettato che garantisce un disaccoppiamento semplice del cono morse

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo e preciso, molto maneggevole. Lo strumentario è suddiviso in 5 cassette, implementabile in base alla complessità dell'intervento e permette di identificare facilmente gli strumenti necessari alla realizzazione dell'impianto programmato, evitando la presenza di strumenti non necessari sul tavolo operatorio, riducendo la possibilità di errore, facilitando il compito dello strumentista; ciò consente anche di rendere più efficienti le procedure di lavaggio e sterilizzazione.

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie molto chiare e ben leggibili, nonché codici colore

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova ben identificabili, presentano una precisa corrispondenza con l'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 12,10 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **LINK ITALIA** per i lotti 7 - 8 - 9. Il sistema offerto in tali lotti è il medesimo

Per la Ditta sono presenti Alessandro Cristini e Daniele Montanaro

Prodotto offerto: EMBRACE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, costituito da varie cassette a seconda dell'intervento.

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 12,25 termina la presentazione.

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente varie soluzioni intra-operatorie, possibilità di conversione anatomica, inversa e CTA

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; basso profilo della base plate con peg disponibili in più misure

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: nel Modello M5 bis "questionario tecnico" la Ditta attesta "Corsi di formazione specifici presso l'accademia LINKademy™ ad Amburgo presso la casa produttrice WALDEMAR LINK GmbH & Co. Programmi di formazione on site e momenti formativi integrativi come presentato nel dettaglio nel documento allegato". Nella busta tecnica non viene peraltro allegato alcun altro documento relativo alla proposta formativa, la quale risulta pertanto non valutabile.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo e nello stesso tempo essenziale, pratico, manici ergonomici; di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie poco chiare essendo sullo sfondo di un cestello traforato; nelle cassette per la versione anatomica e inversa stemmed ci sono codici colore sia sullo strumentario che sul prodotto, di facile lettura

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura. Apertura molto agevole perché la confezione presenta una chiara indicazione del punto di apertura


LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente varie soluzioni intra-operatorie, possibilità di conversione anatomica, inversa e CTA

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; basso profilo della base plate con peg disponibili in più misure

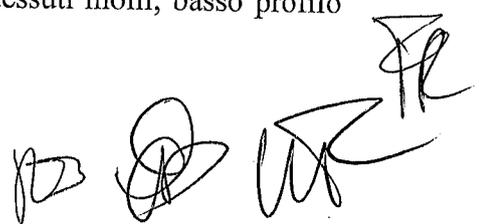

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: nel Modello M5 bis "questionario tecnico" la Ditta attesta "Corsi di formazione specifici presso l'accademia LINKademy™ ad Amburgo presso la casa produttrice WALDEMAR LINK GmbH & Co. Programmi di formazione on site e momenti formativi integrativi come presentato nel dettaglio nel documento allegato". Nella busta tecnica non viene peraltro allegato alcun altro documento relativo alla proposta formativa, la quale risulta pertanto non valutabile.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell'inserto (Q5)

Osservazioni: sì

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo e nello stesso tempo essenziale, pratico, manici ergonomici

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono serigrafie poco chiare essendo sullo sfondo di un cestello traforato; nelle cassette per la versione anatomica e inversa stemmed ci sono codici colore sia sullo strumentario che sul prodotto, di facile lettura

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova forniscono un'ottima rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio e permettono una simulazione completa dell'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio, chiara etichettatura. Apertura molto agevole perché la confezione presenta una chiara indicazione del punto di apertura


*** **

Alle ore 12,35 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **STRYKER ITALIA SRL S.U.** per i lotti 8 - 9. Il sistema offerto in tali lotti è il medesimo, cambia lo stelo.

Per la Ditta sono presenti Alessandra Canepa, Maurizio Lanzafame, Paolo Vitali e Eleonora Sini

Prodotto offerto: ASCEND FLEX

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

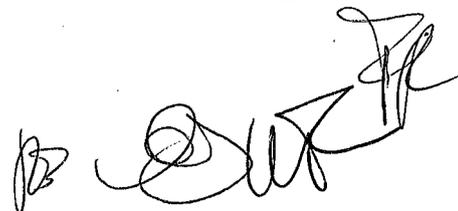

Viene mostrato lo strumentario, composto da 2 cassette per la parte omerale e 2 cassette di glena
Viene illustrata la tecnica chirurgica.
Alle ore 12,57 termina la presentazione.

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema offerto consente una buona varietà di soluzioni intra operatorie per il ripristino dell'anatomia.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; basso profilo della base plate con peg sottile

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, Visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta abbastanza facile, non è prevista vite di espulsione ma utilizzo di una forchetta che può non essere agevole

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell'inserto (Q5)

Osservazioni: sì

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario completo, preciso ma un po' indaginoso nel testare le opzioni di montaggio

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore e serigrafie chiare e ben leggibili



Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova complete, corrispondenti all'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

Alle ore 13,08 inizia la presentazione dello stelo del lotto 9.

Stelo retto e modulare.

Alle ore 13,20 termina la presentazione

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema offerto consente una buona varietà di soluzioni intra operatorie per il ripristino dell'anatomia.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; basso profilo della base plate con peg sottile

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, Visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta abbastanza facile, non è prevista vite di espulsione ma l'utilizzo di una forchetta che ad avviso della Commissione può non essere agevole

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)


Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario completo, preciso ma un po' indaginoso nel testare le opzioni di montaggio

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono codici colore e serigrafie chiare e ben leggibili

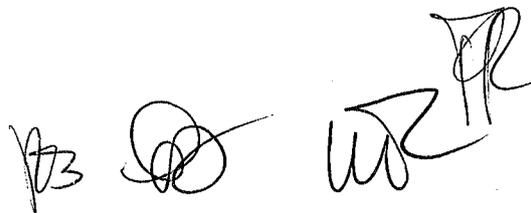

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova complete, corrispondenti all'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 13,40 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **PERMEDICA S.P.A.** per i lotti 7 - 8 - 9. Il prodotto offerto in tali lotti è il medesimo
Per la Ditta sono presenti Lorenzo Frigerio e Giorgio Oragano

Prodotto offerto: MIRAI

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da 4 cassette per l'impianto standard + una cassetta opzionale per la revisione

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 14,00 termina la presentazione.

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente un'ampia gamma di soluzioni intra-operatorie; glena destra e sinistra

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto in presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; metaglena di piccolo diametro, poco invasiva

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale


Osservazioni: molto buono il programma formativo proposto. Sono previsti workshop dimostrativi, eventi di Professional Education supportati da esperti e specialisti di prodotto, sessioni formative e di aggiornamento con cadenza semestrale di durata di 4 ore/sessione, con l'obiettivo di addestrare il personale medico e infermieristico alla gestione e alla manutenzione degli strumentari, articolando le lezioni con una presentazione teorica e un successivo workshop pratico, oltre alla possibilità per il personale medico di partecipare a Cadaver-Lab organizzati presso il centro ICLO di Verona, supportati da Faculty nazionali e internazionali.

Sono periodicamente organizzate visite "surgeon-to-surgeon" e fellowship anche a livello internazionale per diffondere le tecniche di impianto e integrare la formazione teorica.

Per facilitare l'apprendimento da parte del personale della Sala Operatoria, la ditta fornisce inoltre dépliant illustrativi, tecniche chirurgiche e lucidi radiografici (in formato cartaceo e piattaforme digitali).

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica risulta un facile assemblaggio e disassemblaggio delle componenti, c'è apposito strumentario per disassemblaggio

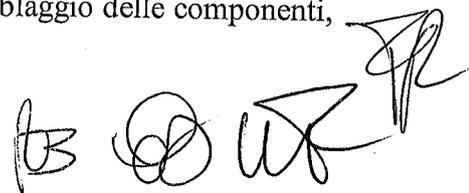

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo, semplice, intuitivo, maneggevole, di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore delle glenosfere e sul corrispettivo dell'inserto; non ci sono serigrafie nella cassetta ma solo sul relativo coperchio, il che risulta poco utile

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova permettono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: il sistema proposto consente un'ampia gamma di soluzioni intra-operatorie; glena destra e sinistra

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema proposto in presenta bassa invasività ossea e sui tessuti molli; metaglena di piccolo diametro, poco invasiva

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: buono il programma formativo proposto. Sono previsti workshop dimostrativi, eventi di Professional Education supportati da esperti e specialisti di prodotto, sessioni formative e di aggiornamento con cadenza semestrale di durata di 4ore/sessione, con l'obiettivo di addestrare il personale medico e infermieristico alla gestione e alla manutenzione degli strumentari, articolando le lezioni con una presentazione teorica e un successivo workshop pratico, oltre alla possibilità per il personale medico di partecipare a Cadaver-Lab organizzati presso il centro ICLO di Verona, supportati da Faculty nazionali e internazionali.

Sono periodicamente organizzate visite "surgeon-to-surgeon" e fellowship anche a livello internazionale per diffondere le tecniche di impianto e integrare la formazione teorica.

Per facilitare l'apprendimento da parte del personale della Sala Operatoria, la ditta fornisce inoltre dépliant illustrativi, tecniche chirurgiche e lucidi radiografici (in formato cartaceo e piattaforme digitali).

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P3' followed by a stylized name, and there are additional initials to the right.

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica risulta un facile assemblaggio e disassemblaggio delle componenti, c'è apposito strumentario per disassemblaggio

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell'inserto (Q5)

Osservazioni: sì

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo, semplice, intuitivo, maneggevole, di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore delle glenosfere e sul corrispettivo dell'inserto; non ci sono serigrafie nella cassetta ma solo sul relativo coperchio, il che risulta poco utile

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova permettono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

La seduta si interrompe dalle ore 13,20 alle ore 13,40 per la pausa pranzo.

*** **

Alle ore 14,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.** per i lotti 7 - 8 - 9.

Per la Ditta sono presenti Alfredo De Stefanis e Davide Bagnasco

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)


Prodotto offerto: COMPREHENSIVE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da due cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 15,00 termina la presentazione.

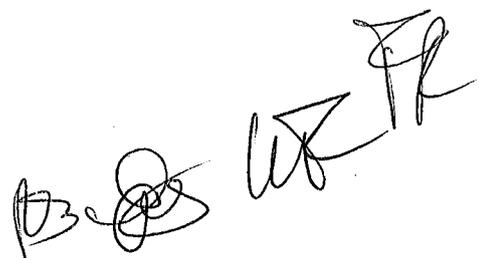

Durante la presentazione della campionatura emerge che il sistema offerto non presenta viti di bloccaggio tra le varie componenti ma solo cono Morse. Considerato che nel lotto 7 il Capitolato prevede quale requisito di minima che *“gli accoppiamenti tra le varie componenti dovranno essere realizzati mediante cono Morse e viti di bloccaggio”*, la Commissione si riserva di meglio esaminare la documentazione tecnica relativa a tale lotto in successiva seduta riservata; decide pertanto di rinviare l’attribuzione dei punteggi per il lotto 7 all’esito di tale ulteriore valutazione.

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

Alle ore 15,10 inizia la presentazione della campionatura del lotto 8

Prodotto offerto: BIGLIANI-FLATOW

La Commissione procede all’apertura di una confezione del prodotto.

Viene mostrato lo strumentario, composto da 3 cassette (una con le prove e i battitori, una per la glena e una con alesatori e preparazione dell’omero)

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 15,28 termina la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: ampia varietà di soluzioni intra-operatorie consentite, ci sono componenti protesiche sia in versione tradizionale che anallergiche; disponibile metaglena con wedge per colmare eventuali difetti ossei della glena

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema presenta una bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto dettagliata il programma formativo proposto, gli strumenti utilizzati e le relative modalità. Non viene fornita una calendarizzazione

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: assemblaggio e disassemblaggio delle componenti molto semplice, ci sono strumenti dedicati;

Presenza di pianificazione digitale relativa all’impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì

Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico (Q5)

Osservazioni: sì

Diversi gradi di inclinazione dell’inserto (Q5)

Osservazioni: sì

Differenti eccentricità della glenosfera (Q5)

Osservazioni: sì

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo, essenziale, non ridondante, maneggevole e preciso, di facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore per accoppiamento inserto e glenosfera e serigrafie molto chiare, ben rappresentate

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: molto ben fatte le componenti di prova, c'è la possibilità di riprodurre fedelmente l'impianto definitivo sulla base di quello di prova

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Alle ore 15,40 inizia la presentazione della campionatura del lotto 9

Prodotto offerto: ANATOMICAL SHOULDER

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da 3 cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 15,50 termina la presentazione.

Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite

Osservazioni: eccellente varietà di soluzioni intra operatorie, stelo cementato e non, sia anatomica che endoprotesi che inversa

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema presenta una bassa invasività ossea e sui tessuti molli, le glene sono poco invasive; il design della protesi consente un'eccellente ricostruzione della porzione metafisaria grazie allo stelo riempitivo ed alla presenza degli spike per la stabilità primaria delle tuberosità senza necessità di cementazione

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto dettagliata il programma formativo proposto, gli strumenti utilizzati e le relative modalità. Non viene fornita una calendarizzazione

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: assemblaggio e disassemblaggio delle componenti molto semplice, ci sono strumenti dedicati

Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto (Q5)

Osservazioni: sì

Componenti anallergiche (Q5)

Osservazioni: sì



Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: strumentario molto completo, compatto, preciso, maneggevole

Identificazione dei componenti

Osservazioni: codici colore per la lateralità; sono presenti serigrafie

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: molto ben fatte le componenti di prova, c'è possibilità di riprodurre fedelmente l'impianto definitivo sulla base di quello di prova

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alla luce di quanto emerso nel corso della presente seduta, le tabelle riepilogative dei punteggi dei lotti 7 – 8 – 9 verranno allegate al verbale della seduta riservata nella quale la Commissione procederà all'ulteriore esame della documentazione tecnica di Limacorporate per i lotti 8 e 9 e Zimmer Biomet Italia per il lotto 7.


La seduta si chiude alle 16,00

Letto, confermato e sottoscritto.


Genova, 11/01/2024

Presidente Commissione Giudicatrice


Dott. Marcello FEDERICI

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott.ssa Emanuela DAPELO


**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Francesco RATTO

**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE



Genova, 18/01/2024

Prot. n. NP/2024/0063007

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
 tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

5^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 5^ seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 18/01/2024, alle ore 8,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per l'esame della campionatura ed attribuzione dei punteggi dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione inizia l'esame della campionatura delle Ditte partecipanti.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ai parametri *de quibus* vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 8,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta EPISCAN SRL per i lotti 14 e 15. Si precisa che i prodotti offerti in tali lotti sono i medesimi Per la Ditta e presente Fabio Zambelli.

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

Prodotto offerto: PROTESI TIBIOTARSICA ANALLERGICA AAA

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da 2 cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 9,05 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 5 taglie

Numero spessori inserto in polietilene

Osservazioni: 4 spessori

Possibilità di impianto con o senza cemento

Osservazioni: no

Basso profilo

Osservazioni: profilo delle componenti basso

Presenza di titanio plasma spray

Osservazioni: sì

Materiale di costruzione rivestimento cupola astragalica in lega metallica Cro-Co

Osservazioni: sì

Presenza di compatibilità astragalo da revisione con altre componenti protesiche


Osservazioni: sì

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti risulta semplice, ma la presenza di una pronunciata pinna nella componente tibiale rende più difficoltosa l'eventuale rimozione della componente stessa

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto puntuale e dettagliata il programma formativo proposto con precisa indicazione della tipologia dei corsi (WORKSHOP, DEMO SURGERY e

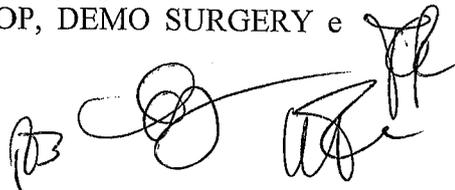

CADAVER LAB, WET-LAB, PRODUCT TRAININGS, corsi di aggiornamento), relativa cadenza, materiale didattico utilizzato, docenti.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: 2 cassette di strumentario; strumentario completo, semplice; utilizzando la versione con maschere custom made la tecnica chirurgica si semplifica moltissimo; facile pulizia e sterilizzazione.

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore degli inserti corrispondenti anche sulle confezioni; ci sono serigrafie non molto chiare

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova risultano corrispondenti agli impianti definitivi e permettono un assemblaggio completo dell'impianto provvisorio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura abbastanza agevole, chiara etichettatura con codice colore degli inserti

*** **

Alle ore 9,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **STRYKER ITALIA SRL S.U.** per i lotti 14 - 18 -19.

Per la Ditta sono presenti Maurizio Lanzafame e Paolo Vitali.

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

Prodotto offerto: INFINITY

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da tre cassette

Viene illustrata la tecnica chirurgica simulando l'assemblaggio e disassemblaggio di un impianto.

Alle ore 9,55 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 5 taglie

Numero spessori inserto in polietilene

Osservazioni: 4 spessori

Possibilità di impianto con o senza cemento

Osservazioni: sì

Basso profilo

Osservazioni: profilo delle componenti basso

Presenza di titanio plasma spray

Osservazioni: sì

Materiale di costruzione rivestimento cupola astragalica in lega metallica Cro-Co Q5
Osservazioni: sì

Presenza di compatibilità astragalo da revisione con altre componenti protesiche Q5
Osservazioni: sì

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: tre cassette di strumentario; lo strumentario è molto completo, preciso, maneggevole; apprezzabile la possibilità di utilizzare la versione con maschere custom made che semplifica ulteriormente la tecnica chirurgica; facile pulizia e sterilizzazione.

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie molto chiare, ben rappresentate; sono presenti codici colore su tutte le mascherine

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova risultano corrispondenti agli impianti definitivi e permettono un assemblaggio completo dell'impianto provvisorio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura molto agevole, chiara etichettatura

Alle ore 10,05 inizia la presentazione della campionatura del lotto 18

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

Prodotto offerto: SWANSON ARTICOLAZIONE DITO

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 10,12 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 11

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: protesi conservativa; la possibilità di avere molte taglie consente massimo risparmio osseo



Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, Visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta di strumentario; strumentario completo, semplice, non prevede mascherine di taglio ma solo dei preparatori per l'alloggiamento della componente protesica; facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore; non ci sono serigrafie ma lo strumentario è organizzato in modo tale da riconoscere facilmente le taglie di prova e gli alesatori

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova precise, consentono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura molto agevole, chiara etichettatura

Alle ore 10,17 inizia la presentazione della campionatura del lotto 19

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

Prodotto offerto: MOOVIS

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 10,25 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 10 misure

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale


Osservazioni: viene descritto in maniera dettagliata il programma formativo e le tipologie di corsi proposti (S2S Surgeon to surgeon, Meeting monotematici con presentazioni a podio e sessioni interattive di confronto di casi inerenti al tema trattato, Cadaver labs, Meeting specializzandi, visita a stabilimenti di produzione Stryker).

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta di strumentario; strumentario completo, di semplice utilizzo, permette una precisa preparazione dell'alloggiamento dell'impianto; facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie chiare e ben leggibili e codici colore

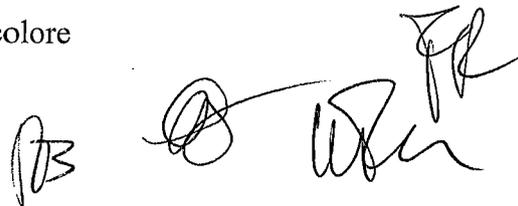

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova sono complete (sia del cotile che dello stelo protesico) e consentono una rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

*** **

Alle ore 10,30 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.** per il lotto 14.

Per la Ditta sono presenti Davide Bagnasco e Elisa Sgabussi

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

Prodotto offerto: TM ANKLE

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da tre cassette (una per il posizionamento della caviglia)

Dalla presentazione della campionatura e da un ulteriore esame della documentazione tecnica emerge che il prodotto offerto presenta solo 3 spessori (+0mm, +2mm, +4mm) e non 4 spessori come richiesto dal capitolato quale requisito minimo a pena di esclusione.

La ditta verrà pertanto esclusa dal lotto.

Alle ore 10,35 termine la presentazione.

*** **

Alle ore 10,45 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **EVOLUZIONI MEDICHE SRL UNIPERSONALE** per i lotti 18 -24.

Per la Ditta è presente Mauro Bonaria.

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

Prodotto offerto: DIGITALIS

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 10,55 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 4 misure interfalangee + 5 metacarpo-falangee

Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: il sistema consente di preparare l'alloggiamento della protesi con adeguate maschere di taglio a risparmio osseo

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: programma formativo molto sintetico, non dettagliato, un po' scarno e superficiale; sono previste le attività minime richieste dalla lex specialis ma non viene ben descritta la modalità di partecipazione/accesso, la cadenza, gli strumenti didattici.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta di dimensioni molto contenute, strumentario molto compatto, essenziale ma completo, preciso; con un'unica broccia si può preparare il canale endomidollare per tutte le taglie; ben organizzato all'interno della cassetta, diviso in 2 parti, una per impianto metacarpo-falangee e uno per l'impianto delle interfalangee; nell'impianto di prova non è riportata la misura numerica presente invece sullo strumentario; utile la presenza di strumento dedicato per valutare la tensione e la misura prima della preparazione dei canali; facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: non ci sono codici colore nè serigrafie

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova bene rappresentate, corrispondono all'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura

Alle ore 11,05 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta nel lotto 24

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

Prodotto offerto: CapFlex

Materiale: titanio cromo-cobalto

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,15 termina la presentazione.

*** *** ***

Alle ore 11,25 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **MIKAI SPA** per i lotti 18 -19.

Per la Ditta sono presenti Saverio Barbara e Roberto Guarino.

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

Prodotto offerto: KERIFLEX

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,30 termine la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 6 misure per le falangee + 7 misure metacarpo-falangee



Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli

Osservazioni: protesi conservativa; la possibilità di avere molte taglie consente massimo risparmio osseo; il design protesico presenta una superficie ad angoli smussi della porzione totale per ridurre l'impingement tendineo

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto puntuale e dettagliata il programma formativo proposto con precisa indicazione della tipologia dei corsi, luogo di svolgimento, durata, modalità, documenti rilasciati, materiale tecnico fornito, coordinatori e destinatari dei corsi.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta compatta, un unico strumentario che permette l'impianto delle interfalangee che delle metacarpo- falangee; ci sono raspe progressive a seconda delle misure; piccola fresina da montare a motore che può aiutare ad aprire il canale; facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: ci sono codici colore corrispondenti anche all'impiantabile; non ci sono serigrafie ma ciò non compromette la facilità di identificazione dei componenti data la semplicità dello strumentario

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova bene rappresentate, corrispondono all'impianto definitivo

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura molto agevole, chiara etichettatura con codici colore anche sulla confezione dell'impiantabile

Alle ore 11,40 inizia l'esame della campionatura del lotto 19

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

Prodotto offerto: TOUCH

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 11,50 termine la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 16 misure

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti


Osservazioni: alla prova pratica le componenti risultano di facile assemblaggio e disassemblaggio

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: viene descritto in maniera molto puntuale e dettagliata il programma formativo proposto con precisa indicazione della tipologia dei corsi, luogo di svolgimento, durata, modalità, documenti rilasciati, materiale tecnico fornito, coordinatori e destinatari dei corsi.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta di strumentario; strumentario completo, compatto, semplice, funzionale, manici ergonomici in gomma dei cacciaviti; facile pulizia e sterilizzazione

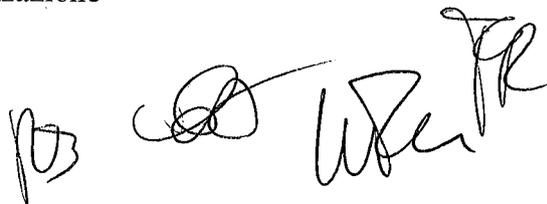

Identificazione dei componenti

Osservazioni: sono presenti serigrafie chiare, ben rappresentate e codici colore dei colletti con corrispondenza sull'impiantabile

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: componenti di prova bene rappresentate, corrispondono all'impianto definitivo in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio. Lo strumentario consente di avere un'idea accurata e precisa di quello che sarà l'impianto definitivo grazie all'ampia varietà di prove che possono essere fatte.

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura molto agevole, chiara etichettatura con codici colore anche sulla confezione dell'impiantabile

*** **

Alle ore 12,00 inizia la presentazione della campionatura dei prodotti offerti dalla ditta **CORMED SAS** per il lotto 19.

Per la Ditta è presente Claudio Corò.

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

Prodotto offerto: MAIA

La Commissione procede all'apertura di una confezione del prodotto

Viene mostrato lo strumentario, composto da una cassetta

Viene illustrata la tecnica chirurgica.

Alle ore 12,15 termina la presentazione.

Numero misure impianto

Osservazioni: 17 misure

Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti

Osservazioni: alla prova pratica l'assemblaggio e disassemblaggio delle componenti è molto facile, ci sono strumenti dedicati per la rimozione ed il disassemblaggio delle componenti

Corsi di formazione ed aggiornamento del personale

Osservazioni: il programma formativo proposto risulta piuttosto scarno e poco dettagliato nei contenuti, modalità, strumenti.

Efficienza nell'utilizzo

Osservazioni: una cassetta; strumentario molto completo, compatto; ci sono maschere di taglio, frese manuali e motorizzate, strumento per la prova del press-fit del cotile, diversi retrattori di diverse misure per migliorare l'esposizione dell'osso, maschera per il centramento del filo del trapezio anatomica. Possibilità di sterilizzazione con o senza cassetta

Utile la guida di tracciabilità che viene consegnata insieme allo strumentario, la guida per la pulizia dello strumentario, guida per assemblaggio e disassemblaggio delle componenti.

Facile pulizia e sterilizzazione

Identificazione dei componenti

Osservazioni: codici colore con corrispondenza sulle confezioni, serigrafie molto chiare, ben rappresentate che indicano anche il verso degli strumenti

Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio

Osservazioni: le componenti di prova sono bene rappresentate, consentono una corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio. Lo strumentario consente di avere un'idea accurata e precisa di quello che sarà l'impianto definitivo grazie all'ampia varietà di prove che possono essere fatte.

Confezionamento

Osservazioni: confezione di ridotte dimensioni e facile stoccaggio; apertura agevole, chiara etichettatura con codici colore

Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi dei lotti 14 - 15 - 18 - 19 - 24

La seduta si chiude alle 12,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 18/01/2024

Presidente Commissione Giudicatrice

Dott. Marcello FEDERICI




Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO




Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Francesco RATTO



Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	EPISCAN S.R.L.		STRYKER ITALIA s.r.l.						
4 - Basso profilo	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
8 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,5	Dott. Marcello Federici	3,571	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,5	Dott. Francesco Ratto		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA				
		0,714	COEFF.		1,000	COEFF.				
9 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	1	Dott. Marcello Federici	5,000	0,7	Dott. Marcello Federici	3,500	B5	1,000	MAX tra le medie
		1	Dott.ssa Emanuela Dapelo		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		1	Dott. Francesco Ratto		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		1,000	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,700	COEFF.				
10 - Efficienza nell'utilizzo	10	0,7	Dott. Marcello Federici	7,000	1	Dott. Marcello Federici	10,000	B7	1,000	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		1	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto		1	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA		1,000	MEDIA				
		0,700	COEFF.		1,000	COEFF.				
11 - Identificazione dei componenti	5	0,5	Dott. Marcello Federici	2,500	1	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	1,000	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo		1	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,5	Dott. Francesco Ratto		1	Dott. Francesco Ratto				
		0,500	MEDIA		1,000	MEDIA				
		0,500	COEFF.		1,000	COEFF.				
12 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
13 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				




 B3

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261


LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO- TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)	CARATTERISTICHE PRODOTTO			
	CRITERI DI VALUTAZIONE			
	1 - Numero misure impianto			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
EPISCAN S.R.L.	5	5,000	5,000	
STRYKER ITALIA	5	5,000	5,000	
Valore Max	5			
Base d'asta	3			





**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261**


LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO- TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)	CARATTERISTICHE PRODOTTO			
	CRITERI DI VALUTAZIONE			
	2 - Numero spessori inserto in polietilene			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
EPISCAN S.R.L.	4	5,000	0,000	
STRYKER ITALIA	4	5,000	0,000	
Valore Max	4			
Base d'asta	4			

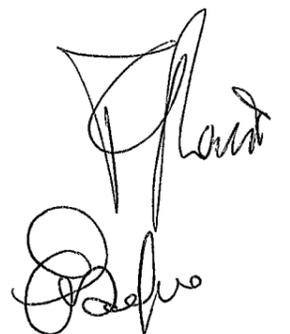Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261	CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	3 - Possibilità di impianto con o senza cemento	5 - Presenza di titanio plasma spray	6 - Materiale di costruzione rivestimento cupola astraglica in lega metallica Cro-Co	7 - Presenza di compatibilità astragalo da revisione con altre componenti protesiche

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

DITTE	Peso Parametro	Punteggio						
EPISCAN S.R.L.	5,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
STRYKER ITALIA srl S.U.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

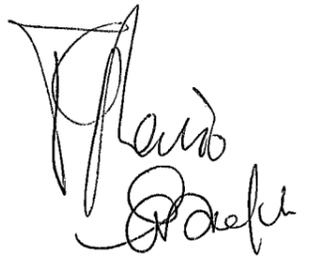LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Numero misure impianto	Q3	5
Numero spessori inserto in polietilene	Q3	5
Possibilità di impianto con o senza cemento	Q5	5
Basso profilo	Q1	5
Presenza di titanio plasma spray	Q5	5
Materiale di costruzione rivestimento cupola astragalica in lega metallica Cro-Co	Q5	5
Presenza di compatibilità astragalo da revisione con altre componenti protesiche	Q5	5
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	5
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5
Efficienza nell'utilizzo	Q1	10
Identificazione dei componenti	Q1	5
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	5
Confezionamento	Q1	5
PUNTEGGIO TOTALE		
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		

EPISCAN S.R.L.	STRYKER ITALIA srl S.U.
5,000	5,000
0,000	0,000
0,000	5,000
5,000	5,000
5,000	5,000
5,000	5,000
5,000	5,000
5,000	5,000
3,571	5,000
5,000	3,500
7,000	10,000
2,5	5
5,000	5,000
5,000	5,000
53,071	63,500
58,504	70,000

Handwritten signatures and initials:
 Left: A stylized signature with 'PB' below it.
 Right: A signature that appears to be 'F. Rando' with another signature below it.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	EPISCAN SRL					
4 - Basso profilo	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
8 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,5	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,500	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,5	Dott. Francesco Ratto				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
9 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	1	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	1,000	MAX tra le medie
		1	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		1	Dott. Francesco Ratto				
		1,000	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
10 - Efficienza nell'utilizzo	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
7 - Identificazione dei componenti	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
11 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
12 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo				
		0,7	Dott. Francesco Ratto				
		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.				

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
1 - Numero misure impianto	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
EPISCAN SRL	5 5,000 5,000
Valore Max	5
Base d'asta	3

CRITERIO DI VALUTAZIONE	
2 - Numero spessori inserto in polietilene	
DITTE	Valore Peso Parametro Punteggio Note
EPISCAN SRL	4 5,000 0,000
Valore Max	4
Base d'asta	4

WR

F. Lani
02/05/15

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –
Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

DITTE	CRITERIO DI VALUTAZIONE											
	Peso Parametro	Punteggio	Note									
EPISCAN SRL	5,000	0,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 BS

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	EPISCAN SRL
Numero misure impianto	Q3	5	5,000
Numero spessori inserto in polietilene	Q3	5	0,000
Possibilità di impianto con o senza cemento	Q5	5	0,000
Basso profilo	Q1	5	5,000
Presenza di titanio plasma spray	Q5	5	5,000
Materiale di costruzione rivestimento cupola astragalica in lega metallica Cro-Co	Q5	5	5,000
Presenza di compatibilità astragalo da revisione con altre componenti protesiche	Q5	5	5,000
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	5	5,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5	5,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	10	10,000
Identificazione dei componenti	Q1	5	5,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	5	5,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			60,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000


 B3
 

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	MIRAI SPA	STRYKER ITALIA s.r.l.																																
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	1	Dott. Marcello Federici	1	Dott.ssa Emanuela Dapelo	1	Dott. Francesco Ratto	1,000	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	B5	1,000 MAX tra le medie
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
1	Dott. Marcello Federici																																			
1	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
1	Dott. Francesco Ratto																																			
1,000	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	<table border="1"> <tr><td>0,3</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,3</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,3</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,300</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,300</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,3	Dott. Marcello Federici	0,3	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,3	Dott. Francesco Ratto	0,300	MEDIA	0,300	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	1	Dott. Marcello Federici	1	Dott.ssa Emanuela Dapelo	1	Dott. Francesco Ratto	1,000	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	B5	1,000 MAX tra le medie
0,3	Dott. Marcello Federici																																			
0,3	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,3	Dott. Francesco Ratto																																			
0,300	MEDIA																																			
0,300	COEFF.																																			
1	Dott. Marcello Federici																																			
1	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
1	Dott. Francesco Ratto																																			
1,000	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
4 - Efficienza nell'utilizzo	15	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	1	Dott. Marcello Federici	1	Dott.ssa Emanuela Dapelo	1	Dott. Francesco Ratto	1,000	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	B7	1,000 MAX tra le medie
1	Dott. Marcello Federici																																			
1	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
1	Dott. Francesco Ratto																																			
1,000	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
5 - Identificazione dei componenti	10	<table border="1"> <tr><td>0,1</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,1</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,1</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,100</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,143</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,1	Dott. Marcello Federici	0,1	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,1	Dott. Francesco Ratto	0,100	MEDIA	0,143	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,5</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,500</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,714</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,5	Dott. Marcello Federici	0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,5	Dott. Francesco Ratto	0,500	MEDIA	0,714	COEFF.	B7	0,700 MAX tra le medie
0,1	Dott. Marcello Federici																																			
0,1	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,1	Dott. Francesco Ratto																																			
0,100	MEDIA																																			
0,143	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,5	Dott. Marcello Federici																																			
0,5	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,5	Dott. Francesco Ratto																																			
0,500	MEDIA																																			
0,714	COEFF.																																			
6 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	1,000	COEFF.	B7	0,700 MAX tra le medie
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
7 - Confezionamento	5	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	1	Dott. Marcello Federici	1	Dott.ssa Emanuela Dapelo	1	Dott. Francesco Ratto	1,000	MEDIA	1,000	COEFF.	<table border="1"> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Marcello Federici</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott.ssa Emanuela Dapelo</td></tr> <tr><td>0,7</td><td>Dott. Francesco Ratto</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>MEDIA</td></tr> <tr><td>0,700</td><td>COEFF.</td></tr> </table>	0,7	Dott. Marcello Federici	0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo	0,7	Dott. Francesco Ratto	0,700	MEDIA	0,700	COEFF.	B7	1,000 MAX tra le medie
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			
1	Dott. Marcello Federici																																			
1	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
1	Dott. Francesco Ratto																																			
1,000	MEDIA																																			
1,000	COEFF.																																			
0,7	Dott. Marcello Federici																																			
0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo																																			
0,7	Dott. Francesco Ratto																																			
0,700	MEDIA																																			
0,700	COEFF.																																			

B5



**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)	CARATTERISTICHE PRODOTTO			
	CRITERI DI VALUTAZIONE			
	1 - Numero misure impianto			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	9	15,000	8,333	
MIKAI SPA	13	15,000	15,000	
STRYKER ITALIA srl S.U.	11	15,000	11,667	
Valore Max			13	
Base d'asta			4	

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Numero misure impianto	Q3	15
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	Q1	10
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5
Efficienza nell'utilizzo	Q1	15
Identificazione dei componenti	Q1	10
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	10
Confezionamento	Q1	5
PUNTEGGIO TOTALE		
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		

EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	MIKAI SPA	STRYKER ITALIA srl S.U.
8,333	15,000	11,667
7,000	10,000	7,000
1,500	5,000	3,500
15,000	10,500	10,500
1,429	10,000	7,143
10,000	10,000	10,000
3,500	5,000	3,500
46,762	65,500	53,310
49,975	70,000	56,972

WR
7/3

Donato

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1

CRITERIO	PUNTI MAX	CORMED SAS	MIRAI SPA	STRYKER ITALIA S.R.L.	
2 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	10	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	85 1,000 MAX tra le medie
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	85 1,000 MAX tra le medie
4 - Efficienza nell'utilizzo	15	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	87 1,000 MAX tra le medie
5 - Identificazione dei componenti	10	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	87 1,000 MAX tra le medie
6 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	87 0,700 MAX tra le medie
7 - Confezionamento	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	87 1,000 MAX tra le medie

B3

Handwritten signatures and initials

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**

N° gara 9103261

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO- METACARPALI (CIG 9831043155)	CARATTERISTICHE PRODOTTO			
	CRITERI DI VALUTAZIONE			
	1 - Numero misure impianto			
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
CORMED SAS	17	15,000	15,000	
MIKAI SPA	16	15,000	14,000	
STRYKER ITALIA srl S.U.	10	15,000	8,000	
Valore Max	17			
Base d'asta	2			




Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Numero misure impianto	Q3	15
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	10
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5
Efficienza nell'utilizzo	Q1	15
Identificazione dei componenti	Q1	10
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	10
Confezionamento	Q1	5
PUNTEGGIO TOTALE		
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO		

CORMED SAS	MIKAI SPA	STRYKER ITALIA srl S.U.
15,000	14,000	8,000
10,000	7,000	7,000
1,500	5,000	3,500
15,000	10,500	10,500
10,000	10,000	10,000
10,000	10,000	10,000
5,000	5,000	3,500
66,500	61,500	52,500
70,000	64,737	55,263

Handwritten signatures and initials:
 [Initials] [Signature] [Signature]

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE			
2 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B5 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,3	Dott. Marcello Federici	5,000	B7 0,300 MAX tra le medie
		0,3	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,3	Dott. Francesco Ratto		
		0,300	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
5 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,7	Dott. Marcello Federici	15,000	B4 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
6 - Identificazione dei componenti	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B5 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
7 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	10	0,7	Dott. Marcello Federici	10,000	B5 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		
8 - Confezionamento	5	0,7	Dott. Marcello Federici	5,000	B7 0,700 MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Emanuela Dapelo		
		0,7	Dott. Francesco Ratto		
		0,700	MEDIA		
		1,000	COEFF.		



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari –

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

CRITERIO DI VALUTAZIONE				
1 - Numero misure impianto				
DITTE	Valore	Peso Parametro	Punteggio	Note
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	11	10,000	10,000	
Valore Max	11			
Base d'asta	4			





fs

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

CRITERIO DI VALUTAZIONE			
4 -Valutazione in ordine al materiale offerto			
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Note
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	Pirocarbonio punti 10 Titanio cromo-cobalto punti 6 Acciaio punti 3	6,000	



 WTC
 P03

**Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede"**


N° gara 9103261

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

CRITERIO	IDENTIF	PUNTI MAX	EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE
Numero misure impianto	Q3	10	10,000
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	Q1	10	10,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	Q1	5	5,000
Valutazione in ordine al materiale offerto	Q5	10	6,000
Efficienza nell'utilizzo	Q1	15	15,000
Identificazione dei componenti	Q1	5	5,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	Q1	10	10,000
Confezionamento	Q1	5	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			66,000
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000

103

 Hand
 Delfe



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEaorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0090106
del 25/01/2024

01/2024

Prot. n. NP/2024/0090106

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

6^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 6^ seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Il giorno 25/01/2024, alle ore 9,00 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere ad un ulteriore esame della documentazione tecnica presentata dalla Zimmer Biomet Italia nel lotto 7 e dalla Limacorporate nei lotti 8 e 9.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente
Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Sono altresì presenti il Dott. Giorgio Sacco in qualità di RUP e la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione ricorda che nel corso della seduta riservata dell'11/01/2024 (verbale NP/2024/0034664) era emerso quanto segue:

1) Per quanto riguarda Zimmer Biomet Italia: durante la presentazione della campionatura del lotto 7 è risultato che il sistema offerto non presenta viti di bloccaggio tra le varie componenti ma solo cono Morse. Considerato che nel lotto 7 il Capitolato prevede quale requisito di minima che *“gli accoppiamenti tra le varie componenti dovranno essere realizzati mediante cono Morse e viti di bloccaggio”*, la Commissione si è riservata di meglio esaminare la documentazione tecnica relativa a tale lotto in successiva seduta riservata.

Nella presente seduta la Commissione procede ad un ulteriore esame di tutta la documentazione tecnica allegata all'offerta del lotto 7. Tale ulteriore esame conferma che effettivamente il sistema offerto dalla Zimmer nel lotto 7 non presenta viti di bloccaggio tra le varie componenti ma solo cono Morse.

La Ditta verrà pertanto esclusa dal lotto 7 in quanto il prodotto offerto non presenta la seguente caratteristica di minima prevista dal Capitolato a pena di esclusione: *“gli accoppiamenti tra le varie componenti dovranno essere realizzati mediante cono Morse e viti di bloccaggio”*.

2) Per quanto riguarda Limacorporate nei lotti 8 e 9: durante la presentazione della campionatura è risultata la mancanza del requisito della presenza di viti che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale per il fissaggio della metaglena. Considerato che trattasi di requisito previsto dal Capitolato a pena di esclusione nei lotti 8 e 9, la Commissione si è riservata di meglio esaminare la documentazione tecnica relativa a tali lotti in successiva seduta riservata.

Nella presente seduta la Commissione procede ad un ulteriore esame di tutta la documentazione tecnica allegata all'offerta dei lotti 8 e 9. Tale ulteriore esame conferma che effettivamente il sistema offerto non presenta viti che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale per il fissaggio della metaglena.

Atteso che il Capitolato tecnico prevede, quale caratteristica di minima a pena di esclusione:

- Lotto 8: *“La metaglena dovrà essere: (...) presenza di fittone centrale ed alloggiamento per viti autofilettanti in titanio che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale”*

- Lotto 9: *“presenza di fittone centrale disponibile in differenti lunghezze e alloggiamento per viti autofilettanti che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale”*

la Ditta viene esclusa dai lotti 8 e 9 in quanto il prodotto offerto non presenta la predetta caratteristica di minima (*“viti autofilettanti che permettano di ottenere una stabilità angolare poliassiale”*).


Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi dei lotti 7 – 8 – 9.

La seduta si chiude alle 12,00.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 25/01/2024

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Marcello FEDERICI



Componente Commissione Giudicatrice
Dott.ssa Emanuela DAPELO

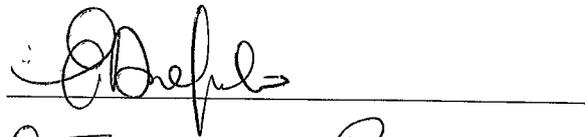

Componente Commissione Giudicatrice
Dott. Francesco RATTO




RUP

Dott. Giorgio SACCO

Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



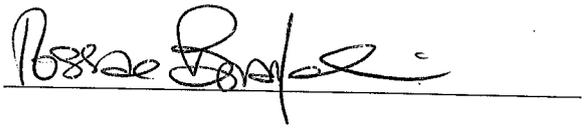

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F) FRAMMENTI (CIG
 983082094C)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1
non valutabile	coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LIMACORPORATE	LINK ITALIA	PERMEDICA SPA	
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intraoperatorie consentite	10	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B4 1,000 MAX tra le medie
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
4 - Facilità di assemblaggio o disassemblaggio delle componenti	5	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
7 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 0,300 MEDIA 0,300 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie
8 - Identificazione dei componenti	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie
9 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	0,1 Dott. Marcello Federici 0,1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,1 Dott. Francesco Ratto 0,100 MEDIA 0,143 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	B7 0,700 MAX tra le medie
10 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie

Pharis

WB *B*

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261	CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
	5 - Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto		6 - Componenti anallergiche	
LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F) FRAMMENTI (CIG 983082094C)				
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio
ARTHREX ITALIA S.R.L	5,000	5,000	2,000	0,000
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	5,000	5,000	2,000	0,000
LIMACORPORATE	5,000	5,000	2,000	2,000
LINK ITALIA	5,000	5,000	2,000	2,000
PERMEDICA SPA	5,000	5,000	2,000	2,000

F. Pano

UP

P
[Signature]

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

**LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)
FRAMMENTI (CIG 983082094C)**

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	10	Q1
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	Q1
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	Q1
Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto	5	Q5
Componenti anallergiche	2	Q5
Efficienza nell'utilizzo	15	Q1
Identificazione dei componenti	5	Q1
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	Q1
Confezionamento	5	Q1

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

ARTHREX ITALIA S.R.L
5,000
7,000
1,500
2,500
5,000
0,000
4,500
3,500
1,143
3,500
33,643
37,087

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
7,000
7,000
5,000
3,500
5,000
0,000
10,500
5,000
8,000
3,500
54,500
60,079

LIMACORPORATE
10,000
10,000
0,000
5,000
5,000
2,000
15,000
5,000
8,000
3,500
63,500
70,000

LINK ITALIA
7,000
7,000
0,000
3,500
5,000
2,000
10,500
3,500
8,000
5,000
51,500
56,772

PERMEDICA SPA
7,000
7,000
3,500
3,500
5,000
2,000
10,500
2,500
8,000
3,500
52,500
57,874

Florio

AO

PS *SO*

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari - Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435895)

Scala dei coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1
non valutabile	coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	ARTHREX ITALIA S.R.L.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LINK ITALIA	PERMEDICA SPA	STRYKER ITALIA s.r.l. S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intraoperatorie consentite	10	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 0,500 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 0,500 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 10,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 7,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 7,000 MEDIA 0,700 COEFF.	B4 1,000 MAX tra le medie
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 4,286 MEDIA 0,300 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 7,143 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 10,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 10,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 10,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 10,000 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 0,700 MAX tra le medie
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	4	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 1,200 MEDIA 0,300 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 4,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
4 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	4	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 2,000 MEDIA 0,500 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 4,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 2,000 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 2,800 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
10 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,3 Dott. Marcello Federici 0,3 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,3 Dott. Francesco Ratto 6,429 MEDIA 0,300 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 15,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 15,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 15,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 10,714 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 15,000 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 0,700 MAX tra le medie
11 - Identificazione dei componenti	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 2,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 2,500 MEDIA 0,500 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 1,000 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie
12 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 8,000 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 0,700 MAX tra le medie
13 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 5,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 3,500 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie

F. Pando

AS

AS

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261	CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
	5 - Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto		6 - Componenti analergiche		7 - Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico		8 - Diversi gradi di inclinazione dell'inserto		9 - Differenti eccentricità della glenosfera	

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

DITE	Peso Parametro		Punteggio		Peso Parametro		Punteggio		Peso Parametro		Punteggio	
	ARTHREX ITALIA S.R.L	4,000	4,000	2,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	4,000	4,000	2,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
LINK ITALIA	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
PERMEDICA SPA	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
STRYKER ITALIA srl S.U.	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	4,000	4,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

F. Ferro PZ



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	LINK ITALIA	PERMEDICA SPA	STRYKER ITALIA srl S.U.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	10	Q1	5,000	5,000	10,000	7,000	5,000	7,000
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	Q1	4,286	7,143	10,000	10,000	10,000	10,000
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	4	Q1	1,200	4,000	0,000	2,800	2,800	2,800
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	4	Q1	2,000	4,000	2,800	2,800	2,000	2,800
Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto	4	Q5	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Componenti anallergiche	2	Q5	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Presenza di componente meta-epifisaria di connessione tra componente omerale ed inserto nella composizione del sistema protesico	1	Q5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Diversi gradi di inclinazione dell'inserto	1	Q5	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Differenti eccentricità della glenosfera	1	Q5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Efficienza nell'utilizzo	15	Q1	6,429	15,000	15,000	15,000	10,714	15,000
Identificazione dei componenti	5	Q1	5,000	2,500	3,500	2,500	5,000	5,000
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	Q1	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Confezionamento	5	Q1	3,500	3,500	5,000	3,500	3,500	3,500
TOTALE PUNTEGGIO			42,414	55,143	63,300	60,600	56,014	63,100
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			46,904	60,979	70,000	67,014	61,943	69,779

Flavio
AK


Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per
 Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N°
 gara 9103261

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO
 PROSSIMALE A 3-4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

Scala dei coefficienti:
 eccellente coeff. 1,0
 ottimo coeff. 0,7
 buono coeff. 0,5
 discreto coeff. 0,3
 sufficiente coeff. 0,1
 non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	LINK ITALIA	PERMEDICA SPA	STRYKER ITALIA S.p.A.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.p.A.	
1 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intraoperatorie consentite	10	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	B4 1,000 MAX tra le medie
2 - Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
3 - Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0 Dott. Marcello Federici 0 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0 Dott. Francesco Ratto 0,000 MEDIA 0,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B5 1,000 MAX tra le medie
4 - Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	B5 0,700 MAX tra le medie
7 - Efficienza nell'utilizzo	15	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,714 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	B7 0,700 MAX tra le medie
8 - Identificazione dei componenti	5	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,5 Dott. Marcello Federici 0,5 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,5 Dott. Francesco Ratto 0,500 MEDIA 0,500 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie
9 - Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'implanto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 1,000 COEFF.	B7 0,700 MAX tra le medie
10 - Confezionamento	5	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	1 Dott. Marcello Federici 1 Dott.ssa Emanuela Dapelo 1 Dott. Francesco Ratto 1,000 MEDIA 1,000 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	0,7 Dott. Marcello Federici 0,7 Dott.ssa Emanuela Dapelo 0,7 Dott. Francesco Ratto 0,700 MEDIA 0,700 COEFF.	B7 1,000 MAX tra le medie

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Initials]

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261	CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
	5 - Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto		6 - Componenti anallergiche	
LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)				
DITTE	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	5,000	5,000	2,000	0,000
LINK ITALIA	5,000	5,000	2,000	2,000
PERMEDICA SPA	5,000	5,000	2,000	2,000
STRYKER ITALIA srl S.U.	5,000	5,000	2,000	2,000
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	5,000	5,000	2,000	2,000

WR

T. Pianta
Edelfu

fbz

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

CRITERIO	PUNTI MAX	ID
Valutazione del sistema proposto in relazione alla varietà di soluzioni intra-operatorie consentite	10	Q1
Valutazione del sistema proposto in relazione alla bassa invasività ossea e sui tessuti molli	10	Q1
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale	5	Q1
Facilità di assemblaggio e disassemblaggio delle componenti	5	Q1
Presenza di pianificazione digitale relativa all'impianto	5	Q5
Componenti anallergiche	2	Q5
Efficienza nell'utilizzo	15	Q1
Identificazione dei componenti	5	Q1
Componenti di prova: Corretta rappresentazione dell'impianto in termini di dimensioni, superfici, peso, assemblaggio	8	Q1
Confezionamento	5	Q1

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
0,000
15,000
5,000
8,000
3,500
60,500
64,656


LINK ITALIA
7,000
7,000
0,000
5,000
5,000
2,000
15,000
5,000
8,000
5,000
59,000
63,053

PERMEDICA SPA
7,000
7,000
3,500
5,000
5,000
2,000
15,000
2,500
8,000
3,500
58,500
62,519

STRYKER ITALIA srl S.U.
5,000
7,000
3,500
3,571
5,000
2,000
10,714
3,500
8,000
3,500
51,786
55,344

ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
10,000
10,000
3,500
5,000
5,000
2,000
15,000
3,500
8,000
3,500
65,500
70,000

Handwritten signatures and initials:
 WP
 P3
 P. P. P.
 P. P. P.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE

Genova, 15/02/2024

Prot. n. NP/2024/ 0179147

UNITÀ ORGANIZZATIVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
 tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche

Il giorno 15/02/2024, alle ore 14,15 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D’Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per procedere all’apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente S.U.A.R., RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. – con funzioni Segretario verbalizzante

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 6700/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Marcello Federici	ASL 2 “Savonese”	Direttore f.f. S.C. Ortopedia e Traumatologia I.P.O. Ponente

Componente	Dott.ssa Emanuela Dapelo	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Componente	Dott. Francesco Ratto	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Sara Bugatto, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2024-0117467 del 31/01/2024.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal Segretario, sotto la supervisione del RUP della procedura, come previsto dal Disciplinare di gara.

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA srl S.U.	55,00	70,00

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA srl S.U.	50,00	70,00

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
LIMACORPORATE srl	70,00	70,00

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
3D SYSTEM SRL	54,50	65,10
ARTHREX ITALIA S.R.L	46,90	56,02

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	58,60	70,00
LIMACORPORATE	55,10	65,82
LINK ITALIA	50,21	59,98
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	56,60	67,61

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	33,64	37,09
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	54,50	60,08
LIMACORPORATE	63,50	70,00
LINK ITALIA	51,50	56,77
PERMEDICA SPA	52,50	57,87

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
ARTHREX ITALIA S.R.L	42,41	46,90
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	55,14	60,98
LINK ITALIA	63,30	70,00
PERMEDICA SPA	60,60	67,01
STRYKER ITALIA srl S.U.	56,01	61,94
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,10	69,78

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,50	64,66
LINK ITALIA	59,00	63,05
PERMEDICA SPA	58,50	62,52

STRYKER ITALIA srl S.U.	51,79	55,34
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	65,50	70,00

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA srl S.U.	61,36	61,36
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	70,00

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
LIMACORPORATE srl	46,20	50,87
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	63,57	70,00

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA srl S.U.	65,00	70,00

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EPISCAN SRL	53,07	58,50
STRYKER ITALIA srl S.U.	63,50	70,00

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EPISCAN SRL	60,00	70,00

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
--------------	-------------------	---------------------------------

BRM EXTREMITIES srl	68,57	70,00
STRYKER ITALIA srl S.U.	58,36	59,57

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	46,76	49,98
MIKAI SPA	65,50	70,00
STRYKER ITALIA srl S.U.	53,31	56,97

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CORMED SAS	66,50	70,00
MIKAI SPA	61,50	64,74
STRYKER ITALIA srl S.U.	52,50	55,26

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	70,00

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	66,00	70,00

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e del prezzo offerto.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\text{min}}) / P$$

con:

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Inoltre, si precisa che poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), si procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.

Si procederà off line per i lotti 3 - 4 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 24 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3. Le tabelle riepilogative dei relativi punteggi economici verranno allegate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ciò precisato, si procede all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	435.263,40	30,00	100,00

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	269.635,08 €	30,00	100,00

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE srl	70,00	198.000,00 €	30,00	100,00

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
3D SYSTEM SRL	65,10	193.536,00	30,00	95,10
ARTHREX ITALIA S.R.L.	56,02	302.400,00	23,77	79,79
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00	361.200,00	15,01	85,01
LIMACORPORATE	65,82	319.200,00	21,26	87,08
LINK ITALIA	59,98	270.480,00	27,35	87,33
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	67,61	237.300,00000	28,49	96,10

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ARTHREX ITALIA S.R.L.	37,09	453.600,00	30,00	67,09
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,08	630.000,00	22,48	82,56

LIMACORPORATE	70,00	554.400,00	28,00	98,00
LINK ITALIA	56,77	731.556,00	4,36	61,13
PERMEDICA SPA	57,87	653.637,60	18,26	76,13

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ARTHREX ITALIA S.R.L	46,90	961.696,00	17,10	64,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	60,98	820.000,00	27,39	88,37
LINK ITALIA	70,00	992.200,00	14,53	84,53
PERMEDICA SPA	67,01	871.332,00	24,73	91,74
STRYKER ITALIA srl S.U.	61,94	765.765,20	28,25	90,19
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	69,78	655.347,28	30,00	99,78

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	64,66	2.080.000,00	28,69	93,35
LINK ITALIA	63,05	2.354.560,00	24,06	87,11
PERMEDICA SPA	62,51	2.234.918,40	27,28	89,80
STRYKER ITALIA srl S.U.	55,34	2.725.008,00	11,74	67,08
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	1.935.240,32	30,00	100,00

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	61,36	€ 746.083,200	29,07	90,43
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 723.120,000	30,00	100,00

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE srl	50,87	€ 417.600,000	30,00	80,87
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 467.248,000	26,81	96,81

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	596.666,40 €	30,00	100,00

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EPISCAN SRL	58,50	€ 381.240,000	27,24	85,74
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	€ 346.231,800	30,00	100,00

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	------------------

		OFFERTO (EURO)		
EPISCAN SRL	70,00	324.760,00 €	30,00	100,00

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
BRM EXTREMITIES srl	70,00	€ 105.300,000	18,05	88,05
STRYKER ITALIA srl S.U.	59,57	€ 63.376,560	30,00	89,57

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	49,98	156.672,00	25,76	75,74
MIKAI SPA	70,00	127.296,00	30,00	100,00
STRYKER ITALIA srl S.U.	56,97	179.193,60	13,50	70,47

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
CORMED SAS	70,00	653.200,00	29,44	99,44
MIKAI SPA	64,74	713.000,00	22,51	87,25
STRYKER ITALIA srl S.U.	55,26	648.945,00	30,00	85,26

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO

		OFFERTO (EURO)		
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	595.650,00 €	30,00	100,00

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	70,00	866.278,40 €	30,00	100,00

Per quanto sopra esposto risultano aggiudicatarie in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti Ditte:

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	435.263,40	30,00	100,00

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	269.635,08 €	30,00	100,00

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE srl	70,00	198.000,00 €	30,00	100,00

LOTTO 6 - PROTESI DI SPALLA STEMLESS (CONSERVATIVA PER PAZIENTI GIOVANI) (CIG 9830382FD7)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	67,61	237.300,00000	28,49	96,10

LOTTO 7 - PROTESI DI SPALLA SISTEMA MODULARE (CIG 983040854F)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
LIMACORPORATE	70,00	554.400,00	28,00	98,00

LOTTO 8 - PROTESI DI SPALLA PER TRATTAMENTO ARTROPATIE E LESIONI MASSIVE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (CIG 9830435B95)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	69,78	655.347,28	30,00	99,78

LOTTO 9 - PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA DELL'OMERO PROSSIMALE A 3- 4 FRAMMENTI (CIG 983082094C)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	1.935.240,32	30,00	100,00

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 723.120,000	30,00	100,00

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,00	€ 467.248,000	26,81	96,81

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	596.666,40 €	30,00	100,00

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	€ 346.231,800	30,00	100,00

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EPISCAN SRL	70,00	324.760,00 €	30,00	100,00

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	59,57	€ 63.376,560	30,00	89,57

LOTTO 18 - PROTESI METACARPO-FALANGEE E INTERFALANGEE NON VINCOLATE (CIG 98310295C6)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
MIKAI SPA	70,00	127.296,00	30,00	100,00

LOTTO 19 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI (CIG 9831043155)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
CORMED SAS	70,00	653.200,00	29,44	99,44

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,00	595.650,00 €	30,00	100,00

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	70,00	866.278,40 €	30,00	100,00

Alle ore 14,41 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 15 (quindici) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.


Genova, 15/02/2024

Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Marcello FEDERICI




Componente Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Emanuela DAPELO



Componente Commissione Giudicatrice

Dott. Francesco RATTO

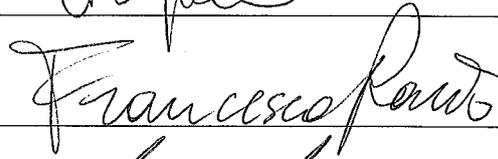

RUP

Dott. Giorgio SACCO




Ufficiale Rogante

Dott.ssa Sara BUGATTO



Funzionario e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

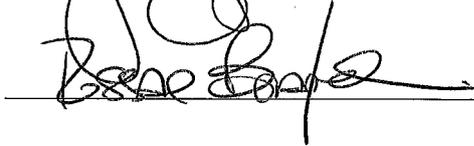

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 3 - PROTESI DI SCAFOIDE (CIG 9830321D81)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,000	€ 436.800,000	435.263,40 €	0,352%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA srl S.U.	0,352%	0,352%



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 4 - PROTESI DI CAPITATO (CIG 983033483D)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,000	€ 270.400,000	269.635,08 €	0,283%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA srl S.U.	0,283%	0,283%



Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 5 - PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO (CIG 98303662A7)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
LIMACORPORATE srl	70,000	€ 277.200,000	198.000,00 €	28,571%	30,000	100,000	LIMACORPORATE srl	28,571%	28,571%

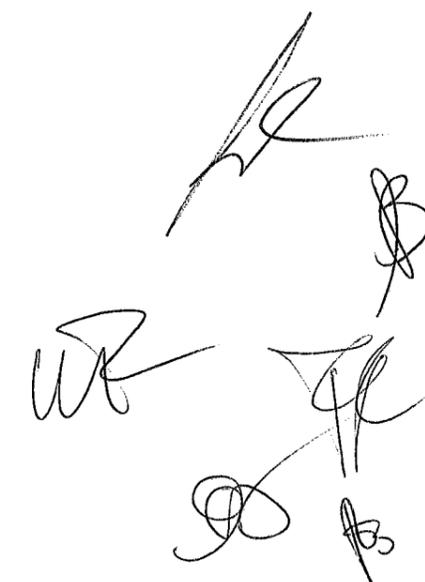

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 10 - PROTESI PER CAPITELLO RADIALE (CIG 9830832335)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA srl S.U.	61,360	€ 883.200,000	€ 746.083,200	15,525%	29,077	90,437		16,825%	18,125%
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,000		€ 723.120,000	18,125%	30,000	100,000	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	16,825%	18,125%

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right and several smaller initials below it.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 12 - PROTESI DI GOMITO SEMIVINCOLATA (CIG 98308512E3)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
LIMACORPORATE srl	50,870	€ 533.600,000	€ 417.600,000	21,739%	30,000	80,870		17,087%	21,739%
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	70,000		€ 467.248,000	12,435%	26,812	96,812	ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.	17,087%	21,739%

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'L' or 'Z' at the top, and several cursive signatures below it.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 13 - PROTESI DI GOMITO NON VINCOLATA/VINCOLABILE (CIG 9830864D9A)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,000	€ 620.400,000	596.666,40 €	3,826%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA srl S.U.	3,826%	3,826%

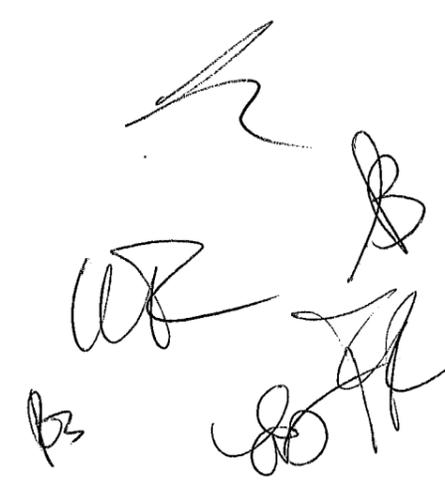

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 14 - IMPIANTO PRIMARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA DEFORMATA DA MALATTIE DEGENERATIVE O ESITI TRAUMATICI (CIG 9830912539)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
EPISCAN SRL	58,500	€ 421.200,000	€ 381.240,000	9,487%	27,245	85,745		13,643%	17,799%
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,000		€ 346.231,800	17,799%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA srl S.U.	13,643%	17,799%

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large stylized signature at the top, a signature with a dollar sign below it, and several other initials and marks at the bottom.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 15 - PROTESI TIBIO-TARSICA ANALLERGICA (CIG 9830945076)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
EPISCAN SRL	70,000	€ 469.200,000	324.760,00 €	30,784%	30,000	100,000	EPISCAN SRL	30,784%	30,784%

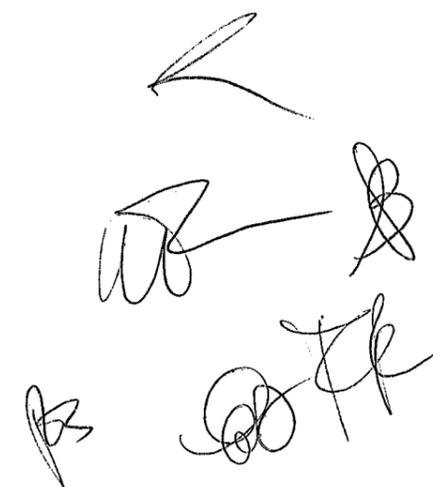

Handwritten signatures and a checkmark.

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 16 - PROTESI PER SOSTITUZIONE PRIMA METARSO FALANGEA IN SILICONE MEDICALE (CIG 9830983FCD)


Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
BRM EXTREMITIES srl	70,000	€ 117.000,000	€ 105.300,000	10,000%	18,056	88,056		27,916%	45,832%
STRYKER ITALIA srl S.U.	59,570		€ 63.376,560	45,832%	30,000	89,570	STRYKER ITALIA srl S.U.	27,916%	45,832%

Handwritten signature and initials:
 A large stylized signature at the top right.
 Below it, the name "BRM" is written vertically on the left.
 In the center, the name "Caviglia" is written in a cursive script.
 At the bottom right, there are several initials and a signature, including "STR" and "B".

Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 20 - PROTESI TRAPEZIO-METACARPALI IN PIROCARBONIO (CIG 98310528C0)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
STRYKER ITALIA srl S.U.	70,000	€ 620.000,000	595.650,00 €	3,927%	30,000	100,000	STRYKER ITALIA srl S.U.	3,927%	3,927%

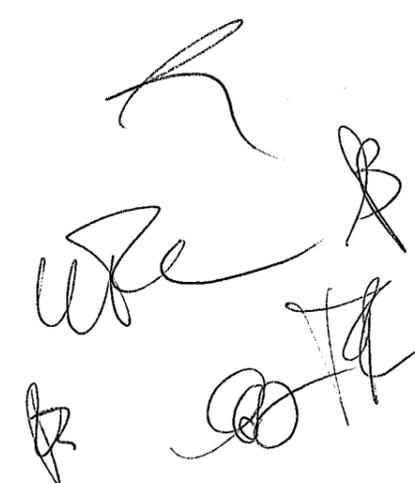


Fornitura di "Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede" N° gara 9103261

LOTTO 24 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE (CIG 9831185682)

Ditta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadriennale	Prezzo offerto	% sconto	Valutazione Economica	Totale Punteggio	Aggiudicatario	Media della % di sconto	Massima % di sconto
EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	70,000	€ 881.600,000	866.278,40 €	1,738%	30,000	100,000	EVOLUZIONI MEDICHE srl UNIPERSONALE	1,738%	1,738%

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, several smaller initials and signatures, including what appears to be '103' and 'OS'.



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE GENERALE
CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 24 – gara n. 9103261. Id Sintel 170429977

RELAZIONE VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale NP/2024/0179147 del 15/02/2024) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte dei seguenti operatori economici:


- 1) CORMED SAS.: lotto 19
- 2) LIMACORPORATE: lotti 5 - 7
- 3) MIKAI S.p.A.: lotto 18
- 4) STRYKER ITALIA SRL S.U.: 3 - 4 - 13 - 14 - 16 - 20
- 5) ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.: lotti 6 - 8 - 9 - 10 - 12

Con note Prot-2024-0193281, Prot-2024-0193298, Prot-2024-0193314, Prot-2024-0193330 e Prot-2024-0193337 del 20/02/2024 è stato pertanto chiesto agli Operatori economici sopra indicati di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per le forniture offerte nei predetti lotti, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

Gli Operatori testè menzionati hanno fornito riscontro con note acquisite agli atti, rispettivamente Prot-2024-0238159, Prot-2024-0230597, Prot-2024-0201322, Prot-2024-0231446 e Prot-2024-0259886, dettagliando in maniera puntuale tutte le voci di costo che compongono le proprie offerte.

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato tutte le giustificazioni pervenute, ritiene le offerte di tutti gli operatori economici sopra indicati nel complesso sostenibili e congrue.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Giorgio SACCO

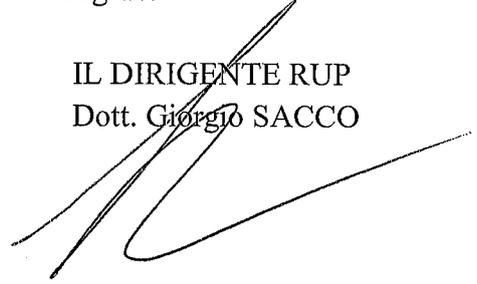

Identificativo atto: 2024-AM-2003

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Giorgio SACCO		-	13-03-2024 08:35
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Giorgio SACCO		-	13-03-2024 08:34
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	12-03-2024 16:36
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Giorgio SACCO		-	12-03-2024 15:38

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria